MERCADO MEDIC	**BEDIENUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG**	CE
	REAL® 9000 PLUS	Letzte Änderung 2020-12-04 Gültig ab 2007-06-01

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Mercado REAL Stuhl! Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Ihr Mercado Medic Deutschland Team

LERNEN SIE IHREN REAL 9000 PLUS KENNEN –

BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGS- UND

PFLEGEANLEITUNG DURCH, BEVOR SIE DEN STUHL NUTZEN.

MERCADO MEDIC
Mercado Medic Deutschland GmbH
Augustinusstraße 11e
50226 Frechen Königsdorf

Telefon
T. +49 2234 809 85 87

E-mail und Internet
info@mercadomedic.de
www.mercadomedic.de

INHALT

ALLGEMEIN: Seite

ANWENDUNGSBEREICH / INDIKATION 3

CE-ZERTIFIZIERUNG 3

WIEDEREINSATZ 3

VORAUSSICHTLICHE LEBENSDAUER 3

TECHNISCHE DATEN 4

STANDARD-LIEFERUMFANG 4

INSPEKTIONSCHECKLISTE VOR DER BENUTZUNG DES STUHLS 5

WICHTIGE INFORMATIONEN UND KLASSIFIKATION 6

LAGERUNG UND REINIGUNG 7

WARTUNGSHINWEISE 8

RICHTLINIEN für INDIVIDUELLE ANPASSUNG DES MERCADO MEDIC PRODUKTS 11

EINSTELLUNGEN UND BEDIENUNG:

BEDIENUNG DER BREMSE 12

SITZHÖHENEINSTELLUNG 12

ANBRINGEN DER RÜCKENLEHNE 12

EINSTELLEN DER RÜCKENLEHNE 13

EINSTELLEN DER ARMLEHNE 14

OPTIONALES ZUBEHÖR:

EINSTELLEN VON ARTHRODESE-SITZELEMENTEN 14

EINSTELLEN DES ZENTRALEN FUßBRETTS 14

EINSTELLEN DES KLEINEN ZENTRALEN FUßBRETTS 15

EINSTELLEN DER MEDIC BEIN- UND FUßSTÜTZE 15

EINSTELLEN DER ELEKTRISCHEN BEIN- UND FUßSTÜTZE 15

SITZNEIGUNGSEINSTELLUNG 16

EINSTELLEN DER KOPFSTÜTZE 17

SITZDREHUNG 17

MONTIEREN UND EINSTELLEN DER SEITENPELOTTE 18

MONTIEREN UND EINSTELLEN DES HÜFTGURTS 18

MONTIEREN UND EINSTELLEN DES BRUSTGURTS 19

MONTIEREN UND EINSTELLEN DER FLEXIBLEN SITZHOSE 19

MONTIEREN UND EINSTELLEN DES TISCHES 20

ANWENDUNGSBEREICH / INDIKATION

Der REAL 9000 PLUS ist ein Arbeits-trippelstuhl mit einer Sitzhöheneinstellung per Gasfeder für den Innenbereich auf ebenem Untergrund.

Der REAL 9000 PLUS EL ist identisch mit dem obengenannten Stuhl, verfügt aber über eine elektrische Höheneinstellung.

INDIKATIONEN
Mobilitätshilfe für den Innenbereich bei Gehbehinderung oder Gehunfähigkeit.
Die Indikationen für den Stuhl mit elektrischer Sitzhöheneinstellung (EL) sind starke Einschränkungen beim Aufstehen oder die Unfähigkeit selbstständig aufzustehen.

KONTRAINDIKATIONEN
Vor einer Versorgung sollten Sie mit Ihrem/Ihrer Arzt /Ärztin abklären, ob Kontraindikationen bestehen.

CE-ZERTIFIZIERUNG

Der REAL 9000 PLUS-Stuhl hat die CE-Zertifizierung gemäß den schwedischen Vorschriften für medizintechnische Produkte LVFs 2003:11.

WIEDEREINSATZ

Der REAL 9000 PLUS ist, nach Reinigung und Inspektion durch einen von uns autorisierten Fachhändler, im vollen Umfang zum Wiedereinsatz geeignet.

VORAUSSICHTLICHE LEBENSDAUER

Bei ordnungsgemäßer Verwendung gemäß dieser Bedienungsanleitung beträgt die voraussichtliche Lebensdauer des Produkts 10 Jahre. Das Herstellungsdatum des Produkts ist zusammen mit der Seriennummer auf einem der silberfarbenen Etiketten mit der Kennzeichnung Lev/Del auf dem Untergestell des Produkts im Format „JJWW“ (Jahr und Kalenderwoche) angegeben.

Wenn das Produkt nicht mehr so gut oder anders als gewohnt funktioniert, sollten sich Anwender des Produkts an die verschreibende oder für Hilfsmittel zuständige Stelle oder den jeweiligen Händlerbetrieb wenden.

Nach Ablauf der voraussichtlichen Lebensdauer ist es wichtig, das Produkt vor der weiteren Verwendung einer Gesamtbeurteilung zu unterziehen. Nach Ablauf der voraussichtlichen Lebensdauer kann Mercado Medic AB die Eignung und Sicherheit des Produkts nicht mehr garantieren, da das Unternehmen keinerlei Kontrolle über Verwendung und Verschleiß des Produkts hat. Wenn das Produkt verschrieben wurde, ist eine solche Gesamtbeurteilung des Produkts von der Pflegeorganisation durchzuführen. Folgende Punkte sind dabei mindestens zu berücksichtigen: Verwendung des Produkts, Zustand des Produkts und seiner Bauteile, ggf. durchgeführte Überholungs- und Wartungsarbeiten und deren Zeitpunkt sowie ergriffene Maßnahmen und deren Grund.

Wenn das Produkt außerhalb von Schweden und Norwegen direkt vom Händler an den Endanwender verkauft wurde und daher eine verschreibende Stelle fehlt, ist neben der oben beschriebenen Gesamtbeurteilung eine regelmäßige Wartung gemäß dem Abschnitt Wartungshinweise durchzuführen.

Nach Ablauf der voraussichtlichen Lebensdauer kann Mercado Medic AB die Verfügbarkeit von Ersatzteilen nicht mehr garantieren. Auf die CE-Kennzeichnung hat die voraussichtliche Lebensdauer keinen Einfluss.

MERCADO MEDIC
Mercado Medic Deutschland GmbH
Augustinusstraße 11e
50226 Frechen Königsdorf
Telefon
T. +49 2234 809 85 87
E-mail und Internet
info@mercadomedic.de
www.mercadomedic.de

TECHNISCHE DATEN

REAL 9000 PLUS

Abmessungen des Rahmens* ohne Beinstützen.	48 x 53 cm Mitte zu Mitte
Gesamthöhe mit niedriger Rückenlehne	ca. 60 cm
Einstellungsmöglichkeiten von:	Sitzhöhe, Rückenlehnen Neigung / Rückenpolsterposition, Armlehnenhöhe, Bremshebel rechts oder links und Breiteeinstellung. *Sonstige Einstellungsmöglichkeiten sind abhängig von der Zusammenstellung des Stuhls.*
Polstermaterial Armauflagen	Polyurethan
Polstermaterial Sitzpolster	Polyurethanpolymer
Polstermaterial Rückenlehne	Polyurethanpolymer
Rahmen	Stahlrohr EN 10305-3, Pulverbeschichtet schwarz

** Abhängig vom Sitzpolster und den Armlehnen wird der Stuhl ggf. breiter.*
*** Standard sind nicht alle Sitzbreiten und Sitztiefen kombinierbar, siehe Preisliste. Andere Sitzgrößen auf Anfrage*

STANDARD-LIEFERUMFANG REAL 9000 PLUS

- Untergestell mit 4 Rollen XL 100 mm und Bremse
- Sitzpolster 44 x 48 cm (BxT) Ergomedic Plus
- Ohne Sitzwinkelfunktion
- Rückenlehne niedrig 38 x 26 cm Ergomedic
- Rückenlehnenverstellung Standard (Lehnenwinkel, Stützwinkel, Höhe: manuell einstellbar)
- Veloursbezug
- Armlehnen 35 cm, schwarzes Kunstleder
- Sitzhöhenverstellung per Gasdruckfeder von 55 bis 90 Kg, hoch, 40-60 cm bis UK Sitzpolster, Bedienung unter der Sitzfläche rechts oder links

Das Sitzpolster, die Rückenlehne und die Armlehnen sind in verschiedenen Maßen und Ausführungen lieferbar. Optional sind auch individuell angefertigte Sitzelemente und weiteres Zubehör erhältlich.

Die aktuellen Preise finden Sie auf unserer Website unter Angebot/Probestuhl.

MERCADO MEDIC
Mercado Medic Deutschland GmbH
Augustinusstraße 11e
50226 Frechen Königsdorf
Telefon
T. +49 2234 809 85 87
E-mail und Internet
info@mercadomedic.de
www.mercadomedic.de

INSPEKTIONSCHECKLISTE VOR DER ERSTEN BENUTZUNG DES STUHLS

- ✓ Stellen Sie die Armlehnen auf die richtige Höhe ein.
- ✓ Befestigen Sie die Rückenlehne und verriegeln Sie den Knopf für die Höheneinstellung der Rückenlehne.
- ✓ Alle Gewindeschrauben müssen auf Festsitzen geprüft werden.
- ✓ Montieren die den Bremshebel (links oder rechts). Nicht bei der elektrische Bremse.
- ✓ Beim Aufstehen oder Hinsetzen muss die Bremse des Stuhls arretiert sein.

Bei elektrische Funktionen:

- ✓ Ziehen Sie den roten Transportschutz von der Ladebuchse
- ✓ Laden Sie den Stuhl lt. Bedienungsanleitung auf

INSPEKTIONSCHECKLISTE VOR JEDER BENUTZUNG DES STUHLS

- ✓ Allgemeine Sichtkontrolle:
  Benutzen Sie niemals ein Gerät, das sich nicht in einwandfreiem Zustand befindet.
- ✓ Überprüfen Sie die Feststellbremse auf Funktion.
- ✓ Beim Aufstehen oder Hinsetzen muss die Bremse des Stuhls arretiert sein.
- ✓ Folgen Sie den Wartungshinweisen, siehe betreffendes Kapitel.
- ✓ Alle Verbindungsteile sind nachzuziehen und zu sichern.

Bei elektrische Funktionen:

- ✓ Laden Sie den Stuhl lt. Bedienungsanleitung auf

MERCADO MEDIC
Mercado Medic Deutschland GmbH
Augustinusstraße 11e
50226 Frechen Königsdorf
Telefon
T. +49 2234 809 85 87
E-mail und Internet
info@mercadomedic.de
www.mercadomedic.de

WICHTIGE INFORMATIONEN UND KLASSIFIKATION

Der REAL 9000 PLUS-Stuhl verfügt über viele Teile, Zubehör und Funktionen, die nach Bedarf individuell eingestellt werden. Der Stuhl sollte nur von der Person und für den Zweck, für den er ursprünglich bestimmt war, verwendet werden.

Der REAL 9000 PLUS:

- ist nach der EMV-Richtlinie EN 60601-1-1 und EN 60601-1-2 geprüft und zugelassen. Die EMV-Anlage kann unter http://www.mercado.se/pdf/swe/3/emc.pdf heruntergeladen werden.
- entspricht der Schutzklasse II, interne Batterie.
- ist in Kategorie B eingestuft.
- muss in der richtigen Verpackung auf einer Palette transportiert werden.
- darf nicht mit Wasser, anderen Flüssigkeiten oder Chemikalien in Berührung kommen.
- Hohe Temperaturen, sowie intensive Sonneneinstrahlung oder ähnliches sollte vermieden werden.
- ist nicht unter 10° Raumtemperatur aufzubewahren.
- ist nur mit Ersatzteilen oder Zubehörteilen von Mercado Medic zugelassen.
- Ist für ein maximales Nutzergewicht von 0-55 Kg, 55-90 Kg oder 90-130 Kg zugelassen, abhängig von der Wahl der Gasdruckfeder. Kontaktieren Sie Mercado Medic, wenn Sie den Stuhl für schwerere Benutzer anpassen möchten.
- darf nicht gefahren werden, wenn sich die Sitzhöhe in der erhöhten Position befindet.

Von einer übermäßigen Nutzung der elektrischen Funktionen ist abzusehen (max. 6 min/h). Bei größerer Auslastung können Defekte entstehen.

Wenn der Stuhl mit einer Sitzwinkelverstellung ausgestattet ist, muss diese Einstellung beim Aufstehen und Hinsetzen arretiert sein.

Reparaturen und andere technische Arbeiten dürfen nur durch von Mercado Medic autorisierte Personen durchgeführt werden.

Dieses Symbol warnt vor einer Gefahr des Einklemmens.

Mercado Medic Deutschland GmbH
Augustinusstraße 11e
50226 Frechen Königsdorf

Telefon
T. +49 2234 809 85 87

E-mail und Internet
info@mercadomedic.de
www.mercadomedic.de

LAGERUNG UND REINIGUNG

Lagern Sie den Stuhl bei Nichtgebrauch in einer trockenen Umgebung bei Zimmertemperatur. Vermeiden Sie hohe Temperaturen und direktes Sonnenlicht.

Das Untergestell sollte sauber und staubfrei gehalten werden. Zum Desinfizieren Benutzen Sie bitte das Desinfektionsmitteln Biguanid Fläche N von der Firma Dr. Schumacher. Führen Sie eine Wischdesinfektion regelmäßig durch. Sprühen sie das Untergestell vor, und anschließend trocken wischen mit einen Sauberen Tuch, nicht mit Wasser, anderen Flüssigkeiten oder Chemikalien reinigen da sonst Beschädigungen entstehen könnten.

Das Velourpolster kann mit Schaumreiniger hygienisch gereinigt werden:

- Entfernen Sie losen Schmutz aus dem Gewebe.
- Tragen Sie eine dünne Schicht handelsüblichen Schaumreiniger auf und reiben Sie ihn mit einem feuchten Tuch gleichmäßig ein.
- Wischen Sie mit einem sauberen, feuchten Tuch nach; maximal 30° Wassertemperatur.
- Nachdem der Stuhl getrocknet ist, gut absaugen.

Das Sitzpolster, die Rückenlehne und andere gepolsterten Teile sind aus funktionalen Gründen aus atmungsaktivem und wasserdurchlässigem Material. Für den Wiedereinsatz des Hilfsmittel, oder bei starken Verschmutzungen, empfehlen wir das gesamte Polsterelement zu erneuern.

Unsere, auf Anfrage erhältliche Inkontinenzbezüge sind bis 60° Waschbar, NICHT in der Zentrifuge und NICHT im Trockner beilegen, hier könnten Materialschäden entstehen!

Das Kunstlederpolster kann mit einen Nassen Tuch abgewischt werden bei eine Wassertemperatur bis 30°, und im Anschluss mit Desinfektionsmittel Biguanid Fläche N von der Firma Dr. Schumacher, wie beim Untergestell bearbeitet werden. Beim Wiedereinsatz des Hilfsmittel oder starken Verschmutzungen, empfehlen wir das Polsterelement komplett zu erneuern.

Falls der Stuhl mit elektrischen Einstellungen ausgestattet ist und über einen Monat nicht benutzt wird, sollte die Batterie abgeklemmt werden.

Für unsere Funbezüge aus Stoff gelten dieselben vorgaben wie bei unseren Velourpolsterungen!

MERCADO MEDIC
Mercado Medic Deutschland GmbH
Augustinusstraße 11e
50226 Frechen Königsdorf
Telefon
T. +49 2234 809 85 87
E-mail und Internet
info@mercadomedic.de
www.mercadomedic.de

WARTUNGSHINWEISE

Wichtige Informationen zur Wiederinstandsetzung und Wartung von REAL 9000 PLUS (im Folgenden das „Produkt“):

- Wenn eine verschreibende Pflegeorganisation für das Produkt verantwortlich ist, bedarf das Produkt keiner regelmäßigen Wartung. Wenn das Produkt außerhalb von Schweden und Norwegen direkt vom Händler an den Endanwender verkauft wurde und daher eine verschreibende Stelle fehlt, ist während der gesamten Lebensdauer des Produkts alle zwei Jahre eine Wartung gemäß den Punkten 1-10 in diesem Abschnitt durchzuführen.
- Bei Service und Instandhaltung ist eine gründliche Sichtprüfung der Hauptkomponenten des Produkts durchzuführen, damit die Sicherheit des Endanwenders gewährleistet ist. Diese umfasst Untergestell, Hubvorrichtung, Sitzkreuz, Rückenlehnenneigung sowie die Breiteneinstellung für die Armlehnen. Zu kontrollieren sind Schweißverbindungen, arretierbare Funktionen und Einstellungen.
- Es ist dem Benutzer untersagt, während der Wiedereinsatz-, Instandsetzungs- oder Wartungsarbeiten auf dem Produkt zu sitzen.
- Bei der Reinigung des Produkts keinen Hochdruckreiniger verwenden.
- Bei der Überprüfung des Untergestells ist die Schweißnaht zwischen vorderen und hinteren Beinen zu kontrollieren. Jegliche Anzeichen von Rissen im Material oder in der Farbe in diesem Bereich sind als Grund anzusehen, das Gestell oder das Produkt zu ersetzen.
- Wenn das Produkt eine schlechte Bremsleistung hat, sollte neben dem Zustand der Bremsfüße auch die Balance des Untergestells überprüft werden. Steht das Produkt bei nicht angezogener Bremse nicht auf allen vier Rollen, ist das Produkt sofort außer Betrieb zu nehmen. Ein eventuelles Ungleichgewicht an mehreren Stellen und in mehreren Richtungen überprüfen, um auszuschließen, dass das Ungleichgewicht auf den Untergrund zurückzuführen ist.

MERCADO MEDIC
Mercado Medic Deutschland GmbH
Augustinusstraße 11e
50226 Frechen Königsdorf
Telefon
T. +49 2234 809 85 87
E-mail und Internet
info@mercadomedic.de
www.mercadomedic.de

1. Elektronikeinheit

☐ 1.1 Elektronik / Funktion / Reinigung

Elektronik überprüfen und kontrollieren, welche elektrischen Funktionen angeschlossen sind. Die elektrischen Funktionen testen. Wenn der Stuhl nicht funktioniert, versuchen das Problem zu lösen, indem das Ladegerät mindestens 10 Sekunden lang angeschlossen wird. Die Elektrobox auf Schäden prüfen.

☐ 1.2. Bedieneinheit / Funktion / Reinigung

Die Funktionen der Bedienelemente überprüfen und kontrollieren, ob das Gehäuse unbeschädigt ist und alle Tasten funktionieren. Die Bedienelemente mit einem leicht mit Desinfektionsmittel befeuchteten Tuch abwischen, um eine eventuelle Ansteckungsgefahr zu minimieren. Lösungsmittel, Bleichmittel, Polituren, synthetische Reiniger, Polierwachs oder Sprays dürfen nicht am Stuhl verwendet werden.

☐ 1.3. Kontakte, Befestigung

Kontrollieren, ob Kabel und Anschlüsse unbeschädigt und sicher befestigt sind. Darauf achten, dass Kabel und Anschlüsse nicht eingeklemmt werden können.

☐ 1.4. Akkus / Ladegerät / Funktion

Kontrollieren, ob das Ladegerät funktioniert und dessen Gehäuse und Kabel nicht beschädigt sind.

Die Akkus messen und kontrollieren, dass der Ladestand der Akkus nicht zu stark abweicht. Dies würde auf eine kaputte Akkuzelle hindeuten.

☐ 1.5. Elektrische Sitwinkelfunktion

Bei Stühlen mit einer elektrischer Sitzwinkelfunktion kontrollieren, dass die Elektrobaugruppe keine sichtbaren Schäden aufweist. Die beweglichen Teile der Elektrobaugruppe auf deren Funktion überprüfen. Sicherstellen, dass alle Feststellschrauben angezogen sind und in der Endposition kein Spiel auftritt.

1.6. Elektrische Rückenlehnenfunktion

Kontrollieren, dass die Elektrobaugruppe keine sichtbaren Schäden aufweist. Die beweglichen Teile der Elektrobaugruppe auf deren Funktion überprüfen. Sicherstellen, dass alle Feststellschrauben angezogen sind und in der Endposition kein Spiel auftritt.

☐ 1.7. Elektrische Bremse / Funktion

Kontrollieren, dass die Elektrobaugruppe keine sichtbaren Schäden aufweist. Die beweglichen Teile der Elektrobaugruppe auf deren Funktion überprüfen. Sicherstellen, dass alle Feststellschrauben angezogen sind und in der Endposition kein Spiel auftritt.

Alle Verbindungen überprüfen und kontrollieren, dass die Klemmhalterung an Bremswelle und Untergestellrohr fest sitzt.

2. Elektrische Hubsäule Ellyftomat

☐ 2.1. Dissonanzen / Rutschkupplung

Auf ungewöhnliche Geräusche aus der elektrischen Hubsäule achten. Elektrische Hubsäule auswechseln, wenn sich ein Lager in schlechtem Zustand befindet. Die elektrische Hubsäule kann zur Reparatur/Wiederinstandsetzung an Mercado Medic AB geschickt werden.

Stuhl belasten und kontrollieren, dass die elektrischen Hubsäule in der untersten Position nicht rutscht. Andernfalls ist die Rutschkupplung auf das richtige Drehmoment einzustellen.

☐ 2.2. Rotationsverriegelung / Schmierung

Kontrollieren, dass die elektrische Hubsäule in Rotationsrichtung kein Spiel hat. Andernfalls die elektrische Hubsäule auswechseln. Die elektrische Hubsäule kann zur Reparatur/Wiederinstandsetzung an Mercado Medic AB geschickt werden.

2.3. Befestigung / Nachziehen

Kontrollieren, dass die Befestigungen am Sitzkreuz und Untergestell sicher angezogen sind.

☐ 2.4. Verkabelung / Verschleiß

Kabel auf Verschleiß und Schäden durch Quetschungen prüfen.

3. Untergestell

☐ 3.1. Schweißverbindungen

Alle Schweißverbinden sorgfältig auf Anzeichen von Rissen, Korrosion, Bewegung usw. prüfen.

☐ 3.2. Schraubverbindungen

Alle Schraubverbindungen prüfen und anziehen. Alle Schrauben mit Schäden an Schlüsselgriff oder Gewinde austauschen.

4. Bremsen

☐ 4.1. Funktion / Verschleiß

Bremsfüße auswechseln und kontrollieren, ob die Bremse zufriedenstellend funktioniert.

☐ 4.2. Kunststoffstecker / Führungsbuchsen

Sicherstellen, dass Führungsbuchsen und Kunststoffstecker sicher befestigt sind. Verschlissene oder beschädigte Teile auswechseln.

5. Lenkrollen

☐ 5.1. Funktion / Rolle / Schwingung

Die Rollen von Staub und Haaren befreien und Lenkrollen und -rahmen auf Verschleiß und Spiel überprüfen (dies kann auf einen schlechten Zustand der Lager hinweisen). Sicherstellen, dass sich die Lenkrollen drehen und die Rahmen ordnungsgemäß rotieren. Lenkrollen bei Bedarf auswechseln.

☐ 5.2. Befestigung / Nachziehen

Prüfen, ob die Schrauben der Lenkrollen unbeschädigt und angezogen sind.

MERCADO MEDIC
Mercado Medic Deutschland GmbH
Augustinusstraße 11e
50226 Frechen Königsdorf
Telefon
T. +49 2234 809 85 87
E-mail und Internet
info@mercadomedic.de
www.mercadomedic.de

6. Sitzrahmen

☐ 6.1. Mechanik / Schweißverbindungen
Alle geschweißten Teile sorgfältig prüfen (insbesondere an der Aufhängung der Sitzwinkelfunktion, da diese Teile am stärksten beansprucht werden).

☐ 6.2. Schraubverbindungen / Nachziehen
Alle Schraubverbindungen prüfen und anziehen. Alle Schrauben mit Schäden an Schlüsselgriff oder Gewinde austauschen.

☐ 6.3. Kunststoffstecker / Führungsbuchsen
Sicherstellen, dass Führungsbuchsen und Kunststoffstecker sicher befestigt sind. Verschlissene oder beschädigte Teile auswechseln.

☐ 6.4. Sitzpolster / Austausch / Reinigung
Sitzfläche ersetzen und eventuelle Bezüge waschen oder austauschen.

☐ 6.5. Bedienung / Schmierung
Prüfen, ob die Handschrauben und Drehknaufe des Sitzkreuzes funktionieren und richtig verriegeln.

☐ 6.6. Sitzwinkelfunktion per Gasfeder
Bei Stühlen mit einer Sitzwinkelfunktion per Gasfeder prüfen, ob eine ordnungsgemäße Arretierung erfolgt und bei Belastung keine allmähliche Veränderung der Verriegelung eintritt. Kabel und Kabelhüllen prüfen und bei Schäden auswechseln.

☐ 6.7. Sitzwinkelfunktion per Drehspindel
Bei Stühlen mit einer Sitzwinkel-Einstellung per Drehspindel prüfen, ob kein Spiel besteht und alle Schrauben angezogen sind.

☐ 6.8. Arthrodesemechanik / Bedienung
Sicherstellen, dass sämtliche Handschrauben für die Arthrodese-Sitzelemente leichtgängig und sicher mit Kontermuttern befestigt sind.

7. Rückenlehnenfunktion

☐ 7.1. Funktion / Verschleiß
Teile auf Verschleiß prüfen und ggf. auswechseln. Bewegliche Teile auf deren Funktionsfähigkeit prüfen.

☐ 7.2. Befestigung / Nachziehen
Sicherstellen, dass alle Schrauben, Handschrauben und Drehknaufe für eine sichere Arretierung sorgen. Prüfen, ob die Federschnäpper fehlerfrei funktionieren.

☐ 7.3. Kunststoffstecker / Führungsbuchsen
Sicherstellen, dass Führungsbuchsen und Kunststoffstecker sicher befestigt sind. Verschlissene oder beschädigte Teile auswechseln.

☐ 7.4. Rückenpolster / Austausch / Reinigung
Rückenpolster ersetzen und eventuelle Bezüge waschen oder austauschen.

☐ 7.5. Gasfeder / Funktion
Gasdruck und Stabilität der Gasfeder überprüfen und sicherstellen, dass die Gasfeder für eine sichere Arretierung sorgt und sich die Position der Rückenlehne bei Belastung nicht allmählich verändert. Kabel und Kabelhüllen prüfen und bei Schäden auswechseln.

8. Armlehnen

☐ 8.1. Funktion / Verschleiß
Teile auf Verschleiß prüfen und ggf. auswechseln. Bewegliche Teile auf deren Funktionsfähigkeit und Arretierung prüfen.

☐ 8.2. Kunststoffstecker / Führungsbuchsen
Sicherstellen, dass Führungsbuchsen und Kunststoffstecker sicher befestigt sind. Verschlissene oder beschädigte Teile auswechseln.

8.3. Armlehnenpolster / Austausch / Reinigung

Armlehnenpolster auswechseln.

☐ 8.4. Armlehnenmechanik / Funktion
Alle Schweißverbindungen überprüfen und sicherstellen, dass das Rohrsystem frei von Schäden ist. Andernfalls kann sich dies nachteilig auf die Konstruktion auswirken.

9. Zubehör

☐ 9.1. Wiederherstellung
Zubehör, das normalerweise nicht am Stuhl angebracht ist, demontieren und wie unten beschrieben kontrollieren, bevor es eventuell im Lager wieder instand gesetzt wird.

☐ 9.2. Mechanik
Alle Schweißverbindungen überprüfen und sicherstellen, dass die Mechanik frei von Schäden ist. Andernfalls kann sich dies nachteilig auf die Konstruktion auswirken.

☐ 9.3. Funktion / Verschleiß
Teile auf Verschleiß prüfen und ggf. auswechseln. Bewegliche Teile auf deren Funktionsfähigkeit und Arretierung prüfen.

☐ 9.4. Polsterteile
Polsterteile entsorgen, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Bezüge entsorgen oder gemäß den Pflegehinweisen waschen.

10. Endkontrolle

☐ 10.1. Funktionstest
Die Funktionen des Stuhls testen und sicherstellen, dass sämtliche Funktionen, elektrischen Funktionen und Bremsen ordnungsgemäß funktionieren. Wenn der Stuhl gelagert werden soll, den Stuhl mit dem hierfür vorgesehenen 9-V-Adapter in den Ruhemodus versetzen, um die Akkus zu schonen.

MERCADO MEDIC
Mercado Medic Deutschland GmbH
Augustinusstraße 11e
50226 Frechen Königsdorf
Telefon
T. +49 2234 809 85 87
E-mail und Internet
info@mercadomedic.de
www.mercadomedic.de

- RICHTLINIEN FÜR DIE INDIVIDUELLE ANPASSUNG DER PRODUKTE VON MERCADO MEDIC AB

Die Anpassungen dürfen nur von Personal durchgeführt werden, das die entsprechenden Schulungen von Mercado Medic AB bezüglich Instandhaltung und Wiederinstandsetzung absolviert hat. Produkte, die sich auf der Liste der genehmigten Produktkombinationen befinden (www.mercado.se/mercado-dokument) dürfen unter Beibehaltung der an Mercado Medic AB erteilten CE-Kennzeichnung montiert werden.

Bei Produkten, die sich nicht auf der Liste der erlaubten Produktkombinationen befinden, muss das entsprechend autorisierte Personal des Kunden zuvor eine schriftliche Genehmigung von Mercado Medic AB einholen.

Die Produkte müssen entweder vom Kunden oder vom Hersteller des betreffenden Produkts zur Bewertung an Mercado Medic AB gesendet werden. Mercado Medic AB bittet dann den Hersteller des Produkts um Stellungnahme, ob eine Kombinationsvereinbarung in Frage kommen würde, und führt eine Risikoanalyse durch. Nach Durchführung der Risikoanalyse erhält der Kunde ein schriftliches Gutachten.

Stühle, die einer wie unten beschriebenen Veränderung unterzogen werden, müssen von Mercado Medic AB verifiziert werden, damit Mercado Medic AB weiter die Produkthaftung obliegt.

- Polsterteile wie Sitzfläche, Rückenlehne, Armlehnen, Seitenstützen, Seitenpelotten und Kopfstütze dürfen angepasst werden, sofern die am Produkt angegebenen max. Einstellungen nicht überschritten werden.
- Der Schwerpunkt über der Hubvorrichtung ist im Sinne einer guten Funktionsweise beizubehalten/zu zentrieren.
- Polsterteile müssen geltende Anforderungen bezüglich Entflammbarkeit und andere Umweltanforderungen erfüllen.
- Flächen, die mit wesentlichen vertikalen Kräften belastet werden, dürfen sich nicht außerhalb der Fläche (Basis) befinden, die von den Rollenmittelpunkten gebildet wird.

Wenn diese Richtlinien erfüllt werden, haftet Mercado Medic AB weiterhin für sein Produkt.

Für Produkte, die nicht gemäß der Richtlinie von Mercado Medic AB angepasst werden, haftet Mercado Medic AB nicht. Änderungen sind von einem Techniker vorzunehmen, der von Mercado Medic AB autorisiert ist. In diesem Fall haftet Mercado Medic AB für sein Produkt gemäß CE-Kennzeichnung und der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.

Bei Fragen zu Anpassungen/Spezialanpassungen wenden Sie sich bitte an Ronny Fogelqvist:

Tel. +46 (0)708 27 96 14
E-Mail ronny.fogelqvist@mercado.se

MERCADO MEDIC
Mercado Medic Deutschland GmbH
Augustinusstraße 11e
50226 Frechen Königsdorf
Telefon
T. +49 2234 809 85 87
E-mail und Internet
info@mercadomedic.de
www.mercadomedic.de

BEDIENUNG DER BREMSE

ACHTUNG!!!!

Die Bremse des Stuhls muss beim Aufstehen und sich Hinsetzen immer arretiert sein. Die Bremse muss regelmäßig überprüft werden. Bei Verschleiß des Bremsfußes, muss das Gummi ersetzt werden.

ES GIBT DREI BREMSSYSTEME
Handbremse, Fußbremse und elektrische Bremse.

BEDIENUNG

1. Bremse PLUS-Rahmen 48: Hebel nach vorne drücken
2. Bremse PLUS-Rahmen 43: Hebel nach vorne oder Fußbremse nach unten drücken
3. Elektrische Bremse: Taste drücken

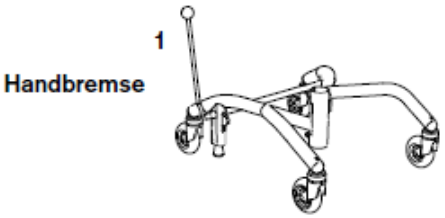



Fußbremse (optional)



Elektrische Bremse (optional)

SITZHÖHENEINSTELLUNG

Es gibt zwei Varianten der Sitzhöheneinstellung:
Mit Gasdruckfeder oder elektrisch einstellbar. Bei beiden ist eine Standardhöhe (hoch) und eine niedrige Grundeinstellung wählbar. Der Bedienhebel der Gasfeder kann unter dem Sitz oder unter der Armlehne angeordnet werden. Die Bedienung der elektrischen Steuerung ist standardmäßig unter der Armlehne.

Die Sitzhöheneinstellung erfolgt stufenlos, beim REAL 9000 PLUS per Gasfeder.

ACHTUNG! Leichte Personen brauchen bei der Verstellung per Gasfeder ggf. Hilfe beim Heben und Senken der Sitzhöhe.

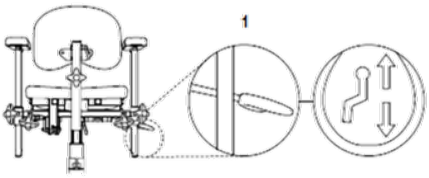



BEDIENUNG
1. Sitzhöheneinstellung per Gasdruckfeder, wird betätigt, indem Sie den Hebel langsam hochziehen. Zum Höher stellen soll der Stuhl entlastet, zum runter stellen belastet werden.

ANBRINGEN DER RÜCKENLEHNE

Um die Rückenlehne anzubringen, drücken Sie den Sicherheitsstift (3) und schieben Sie das Rohr in den Rückenlehneneinstellmechanismus (2) hinein. Um die Rückenlehne zu entfernen, drücken Sie den Sicherheitsstift (3) und schieben Sie das Rohr aus dem Rückenlehneneinstellmechanismus (2) heraus.



Arretieren Sie die Rückenlehne durch das Anziehen der Schraube (4).

MERCADO MEDIC
Mercado Medic Deutschland GmbH
Augustinusstraße 11e
50226 Frechen Königsdorf
Telefon
T. +49 2234 809 85 87
E-mail und Internet
info@mercadomedic.de
www.mercadomedic.de

EINSTELLEN DER RÜCKENLEHNE

Es gibt vier Arten von Rückenlehneneinstell-mechanismen: Standard, Medic, Komfort und Elektrisch. Alle sind als hohe oder niedrige Ausführung lieferbar (alle abgebildeten Stühle haben die niedrige Ausführung).

Alle Rückenlehneeinstellmechanismen haben separate Gewindeschrauben für Höhen-, Tiefen- und Neigungseinstellung. Der Medic-Mechanismus ist extra in der Tiefe einstellbar.

BEDIENUNG

1. Höheneinstellung
2. Neigungseinstellung der Rückenlehne
3. Neigungseinstellung des Rückenpolsters
4. Tiefeneinstellung

Um die Neigung des Rückenpolsters zu variieren, lösen Sie den Schnellspanner (3), positionieren Sie das Polster im gewünschten Winkel und ziehen Sie den Schnellspanner (3) an.



Standard



Medic (Optional)



Komfort (Optional)

Um die Höhe der Rückenlehne zu variieren, lösen Sie die Schraube (1), positionieren Sie die Rückenlehne auf der gewünschten Höhe und ziehen Sie die Schraube (1) an.
Um die Neigung der Rückenlehne zu ändern, lösen Sie die Schraube (2) oder nutzen Sie bei der Komfort-Variante den Bedienhebel der Gasfedereinstellung (2).

Bei der Medic-Variante können Sie durch Lösen der Schraube (4) die Sitztiefe einstellen. Ziehen Sie in der gewünschten Position die Schraube (4) wieder an.

ACHTUNG!
Stellen Sie bei dem Medic-Rückenlehne-Einstellmechanismus sicher, dass die Rückenlehne maximal bis zur Sicherung herausgezogen ist (5)!

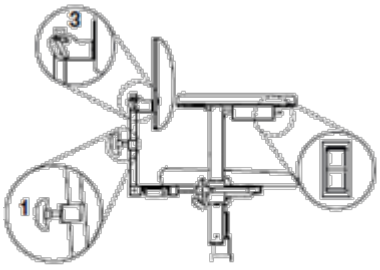

Elektrisch (optional)

Wenn der Stuhl mit einem elektrischen Rückenlehne-Einstellmechanismus ausgestattet ist, kann der Rückenwinkel über den Schalter unter der Armlehne eingestellt werden.

MERCADO MEDIC
Mercado Medic Deutschland GmbH
Augustinusstraße 11e
50226 Frechen Königsdorf
Telefon
T. +49 2234 809 85 87
E-mail und Internet
info@mercadomedic.de
www.mercadomedic.de

EINSTELLEN DER ARMLEHNE

Sie können die Armlehnenposition in Höhe und Breite einstellen. Wenn der Stuhl mit klappbaren Armlehnen ausgestattet ist, können diese heruntergeklappt werden. Zum Herausnehmen der Standardarmlehne, lösen Sie die Schraube (1), drücken Sie den silberfarbenen Sicherheitsstift unten am Armlehnenrohr und ziehen Sie die Armlehne komplett heraus.



Armlehne



Klappbare Armlehne

BEDIENUNG

1. Höheneinstellung
2. Breiteneinstellung
   Lösen Sie jeweils die Gewindeschraube, um die Armlehne zu verstellen. Danach festdrehen.
3. Klappmechanismus

EINSTELLEN VON ARTHRODESE-SITZELEMENTEN (OPTIONAL)

Die Arthrodese-Elemente können eingestellt werden.

Bei Stühlen ohne Sitzwinkelfunktion finden Sie die Bedienung unter der Vorderkante des Sitzes.

BEDIENUNG

1. Lösen Sie die Schraube (1), stellen Sie die gewünschte Neigung ein und ziehen Sie die Schraube wieder an.



Bei Stühlen mit Sitzwinkelfunktion finden Sie die Bedienung unter der Rückenlehne des Sitzes.

BEDIENUNG

2. Drehen Sie die Drehspindel (2), um das betreffende Element zu verstellen.



EINSTELLEN DES ZENTRALEN FUßBRETTS (OPTIONAL)

Sie können das Fußbrett in Höhe und Neigung einstellen und die Neigung der Beinstütze.

Um die Höhe des Fußbretts anzupassen, lösen Sie die Schraube (1) und positionieren Sie das Fußbrett in der gewünschten Position. Ziehen Sie die Schraube (1) an, um das Fußbrett zu fixieren.

Um die Neigung des Fußbretts anzupassen, verstellen Sie die Inbusschraube (2). Je mehr Sie die Schraube rausdrehen, desto mehr neigt sich das Fußbrett.

Um die Neigung der Beinstütze anzupassen, lösen und entfernen Sie die Schraube (3) und positionieren Sie das Fußbrett in einer der vorgegeben Positionen. Platzieren Sie den Abstandsring und die Schraube und ziehen Sie die Schraube (3) an, um die Beinstütze zu fixieren.

MERCADO MEDIC
Mercado Medic Deutschland GmbH
Augustinusstraße 11e
50226 Frechen Königsdorf
Telefon
T. +49 2234 809 85 87
E-mail und Internet
info@mercadomedic.de
www.mercadomedic.de

EINSTELLEN DES KLEINEN ZENTRALEN FUßBRETTS (OPTIONAL)

Sie können das Fußbrett in Höhe und Neigung einstellen und die Neigung der Beinstütze.

Um die Höhe des Fußbretts anzupassen, lösen Sie die Schraube (1) und positionieren Sie das Fußbrett in der gewünschten Position. Ziehen Sie die Schraube (1) an, um das Fußbrett zu fixieren.

Um die Neigung des Fußbretts anzupassen, verstellen Sie die Inbusschraube (2). Je mehr Sie die Schraube rausdrehen, desto mehr neigt sich das Fußbrett.

Um die Neigung der Beinstütze anzupassen, lösen Sie die kleinere Inbusschrauben (3, an beiden Seiten) und positionieren Sie die Beinstütze in der gewünschten Position. Ziehen Sie die Schrauben (3, an beiden Seiten) an, um die Beinstütze zu fixieren.

EINSTELLEN DER MEDIC BEIN- UND FUßSTÜTZE (OPTIONAL)

Sie können die Fußstütze in Höhe und Neigung einstellen und die Neigung der Beinstütze.

Um die Höhe des Fußbretts anzupassen, lösen Sie die Inbusschraube (1) und positionieren Sie das Fußbrett in der gewünschten Position. Ziehen Sie die Schraube (1) an, um das Fußbrett zu fixieren.

Um die Neigung des Fußbretts anzupassen, lösen Sie die Inbusschraube (2) und positionieren Sie das Fußbrett in der gewünschten Position. Ziehen Sie die Schraube (2) an, um das Fußbrett zu fixieren.

Um die Neigung der Beinstütze anzupassen, lösen Sie die Inbusschraube (3) und positionieren Sie die Beinstütze in der gewünschten Position. Ziehen Sie die Schraube (3) an, um die Beinstütze zu fixieren.

EINSTELLEN DER ELEKTRISCHEN BEIN- UND FUßSTÜTZE (OPTIONAL)

Sie können die Fußstütze in Höhe und Neigung einstellen.

Um die Höhe des Fußbretts anzupassen, lösen Sie die Inbusschraube (1) und positionieren Sie das Fußbrett in der gewünschten Position. Ziehen Sie die Schraube (1) an, um das Fußbrett zu fixieren.

Um die Neigung des Fußbretts anzupassen, lösen Sie die Inbusschraube (2) und positionieren Sie das Fußbrett in der gewünschten Position. Ziehen Sie die Schraube (2) an, um das Fußbrett zu fixieren.

Um die Tiefeposition der Fußstütze anzupassen, lösen Sie die Inbusschraube (3) und positionieren Sie die Fußstütze in der gewünschten Position. Ziehen Sie die Schraube (3) an, um die Fußstütze zu fixieren.

Sie können die Neigung der Beinstützen über das elektrische Bedienteil einstellen.

Mercado Medic Deutschland GmbH
Augustinusstraße 11e
50226 Frechen Königsdorf

Telefon
T. +49 2234 809 85 87

E-mail und Internet
info@mercadomedic.de
www.mercadomedic.de

SITZWINKELFUNKTION (OPTIONAL)

Es gibt drei Mechanismen zur Sitzwinkel-einstellung: per Gasdruckfeder, per Drehspindel oder elektrisch. Die Drehspindel bedienen Sie von der Rückseite des Stuhls. Der Neigungsbereich kann mittels der Muttern eingestellt werden. Der Bedienhebel für die Gasfeder ist unter dem Sitz (2) oder optional unter der Armlehne (3). Er wird bedient, indem Sie langsam hochziehen. Die elektrische Sitzwinkelverstellung wird standardmäßig mit dem Schalter (4) bedient.

BEDIENUNG

1. Drehspindeleinstellung unter dem Sitz.
2. Bedienhebel der Gasdruckfeder unter dem Sitz.
3. Bedienhebel der Gasdruckfeder unter der Armlehne.
4. Elektrische Steuerung unter der Armlehne.

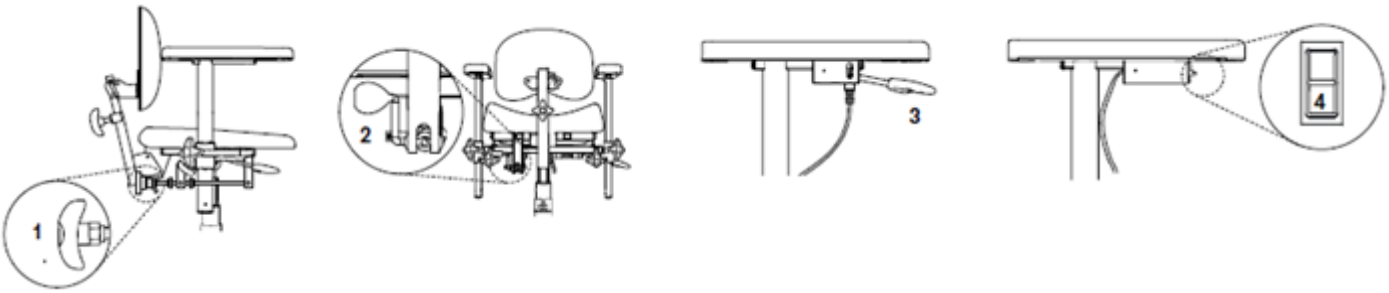

ZUSÄTZLICHER SITZNEIGUNGMECHANISMUS MIT 3 BEREICHEN (OPTIONAL)

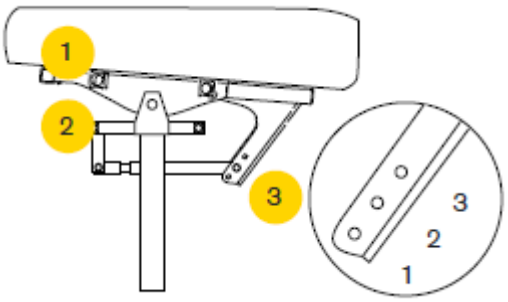

1. Armlehnen, die hier angebracht sind, bewegen sich zusammen mit der Sitzwinkel.
2. Armlehnen, die hier angebracht sind, bewegen sich NICHT zusammen mit der Sitzwinkel
3. Es gibt drei Positionen für die unterschiedlichen Neigungsbereiche.

Pos. 1. 15˚ nach vorne, 8˚ nach hinten - Standardsitzneigung.
Pos. 2. 8˚ nach vorne, 15˚ nach hinten - aktive Sitzneigung.
Pos. 3. 0˚ nach vorne, 23˚ nach hinten - passive Sitzneigung.

ACHTUNG: Position 3 darf nur eingestellt werden wenn der Sitz mit einer Rahmenverlängerung ausgestattet ist!

MERCADO MEDIC
Mercado Medic Deutschland GmbH
Augustinusstraße 11e
50226 Frechen Königsdorf
Telefon
T. +49 2234 809 85 87
E-mail und Internet
info@mercadomedic.de
www.mercadomedic.de

EINSTELLEN DER KOPFSTÜTZE (OPTIONAL)

Um die **Neigung** der Kopfstütze einzustellen, lösen Sie die Schraube (1) und positionieren Sie das Kopfstützenpolster in der gewünschten Position. Ziehen Sie die Schraube (1) an, um das Polster zu fixieren.

Um die **Tiefe** der Kopfstütze einzustellen, lösen Sie die Schraube (3) und drücken Sie das Kopfstützenpolster nach vorne oder ziehen Sie es nach hinten in die gewünschte Position. Ziehen Sie die Schraube (3) an, um das Poster zu fixieren.

Um die Kopfstütze **seitlich** zu verstellen (nicht möglich bei Kopfstützen NS10, NS20 oder NS30), lösen Sie die Schraube (4) und schieben Sie die Kopfstütze in die gewünschte Position. Ziehen Sie die Schraube (4) an, um das Poster zu fixieren.

Um die Kopfstütze **in der Höhe** zu verstellen, lösen Sie die Schraube (5) und schieben Sie die Kopfstütze hoch oder herunter in die gewünschte Position. Ziehen Sie die Schraube (5) an, um das Poster zu fixieren.

SITZDREHUNG (OPTIONAL)

ACHTUNG!!!!

Stellen Sie sicher, dass der Drehungsmechanismus eingerastet ist, bevor Sie sich hinsetzen oder aufstehen. Die Sitzdrehung wird mit der Hebel (1) bedient.



MERCADO MEDIC
Mercado Medic Deutschland GmbH
Augustinusstraße 11e
50226 Frechen Königsdorf
Telefon
T. +49 2234 809 85 87
E-mail und Internet
info@mercadomedic.de
www.mercadomedic.de

MONTIEREN UND EINSTELLEN DER SEITENPELOTTE (OPTIONAL)

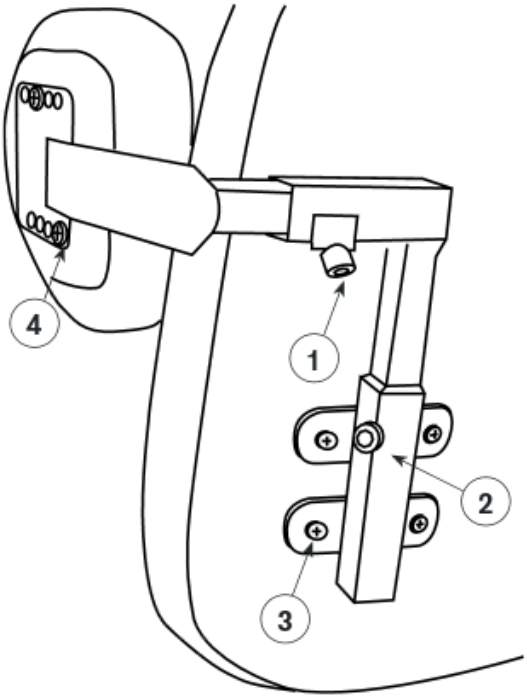

MONTIEREN

Montieren Sie die Seitenpelotte, wie in der Abbildung dargestellt. (Die Abbildung ist von einer Seitenpelotte Standard links.)

Es sind 2 Positionen in der Tiefe möglich. Befestigen Sie das Polster durch die Schrauben (4) in den gewünschten vorgegebenen Löchern im Polster.

EINSTELLEN

Stellen Sie die Höhe und Breite des Seitenpelottenhalterung in eine mittlere Position bevor Sie es am Rückenpolster befestigen. Testen Sie verschiedene Positionen um die richtige zu finden und befestigen Sie den Mechanismus dann mit den Holzschrauben (3).

Die Höhe und Breite der Seitenpelotte können Sie mit Hilfe von Schraube (1) und (2) anpassen.

MONTIEREN UND EINSTELLEN DES HÜFTGURTS (OPTIONAL)

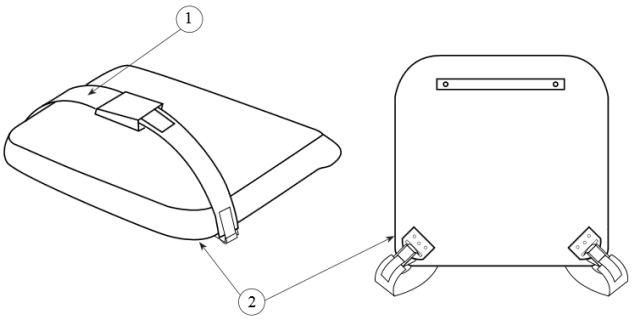

MONTIEREN

Montieren Sie die Klammern (2) auf beiden Seiten in den vorgebohrten Löchern in den hinteren Ecken der Unterseite des Sitzpolsters. Befestigen Sie den Hüftgurt (1) an den Klammern (2).

EINSTELLEN

Passen Sie den Hüftgurt auf die gewünschte Länge an. Nutzen Sie dafür erst das Klett und dann die Clips.

Mercado Medic Deutschland GmbH
Augustinusstraße 11e
50226 Frechen Königsdorf

Telefon
T. +49 2234 809 85 87

E-mail und Internet
info@mercadomedic.de
www.mercadomedic.de

MONTIEREN UND EINSTELLEN DES BRUSTGURTS (OPTIONAL)

MONTIEREN

Montieren Sie die beide oberen und unteren Gurte mit den beigelieferten Klammern. Befestigen Sie den Brustgurt an den Klammern.

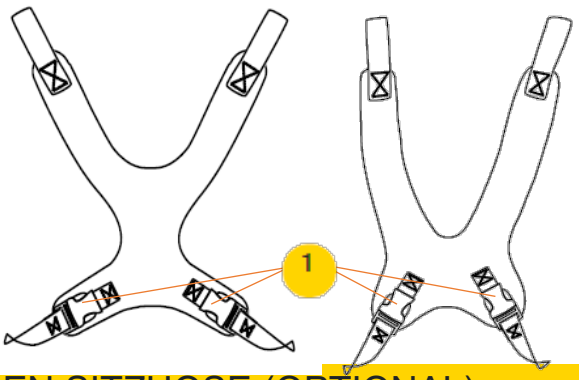

EINSTELLEN

Passen Sie den Brustgurt auf die gewünschte Länge an.

ÖFFNEN UND SCHLIEßEN

Nutzen Sie dafür die Clips (1)

MONTIEREN UND EINSTELLEN DER FLEXIBLEN SITZHOSE (OPTIONAL)

MONTIEREN

Montieren Sie die 2 großen Clips, passend und mittig verteilt unter dem hinteren Bereich des Sitzes.
ACHTUNG: Bitte bohren Sie sich die 2 Großen Clips erst vor damit sie verschraubt werden können.

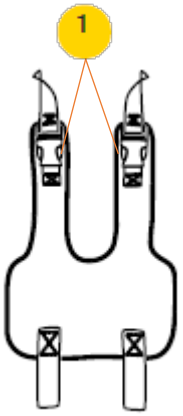

Nach der Montage unterhalb der hintere Sitzpolsterung , fädeln Sie die dafür vorgesehenen Gurte in den Schlaufen ein und sichern diese mit der Klemmvorrichtung.

Jetzt schrauben Sie bitte die 2 kleinen Clips unterhalb der hinteren Sitzpolsterung, etwas seitlich. Achten Sie bitte darauf das genügend Spielraum übrig bleibt um die dazugehörigen Gurte anatomisch um die Oberschenkel anpassen zu können.

EINSTELLEN

Die Anpassung erfolgt über das Nachziehen der 4 Gurte durch die befestigten Schlaufen an den Clips Vorrichtungen!

ÖFFNEN UND SCHLIEßEN

Nutzen Sie dafür die Clips (1)

MERCADO MEDIC
Mercado Medic Deutschland GmbH
Augustinusstraße 11e
50226 Frechen Königsdorf
Telefon
T. +49 2234 809 85 87
E-mail und Internet
info@mercadomedic.de
www.mercadomedic.de

MONTIEREN UND EINSTELLEN DES TISCHES (OPTIONAL)

Montieren Sie den Tisch gemäß Bild A und B auf der linken herausgenommenen Armlehne. Montieren Sie die Armlehne wieder auf dem Stuhl und stellen Sie die richtige Höhe ein.

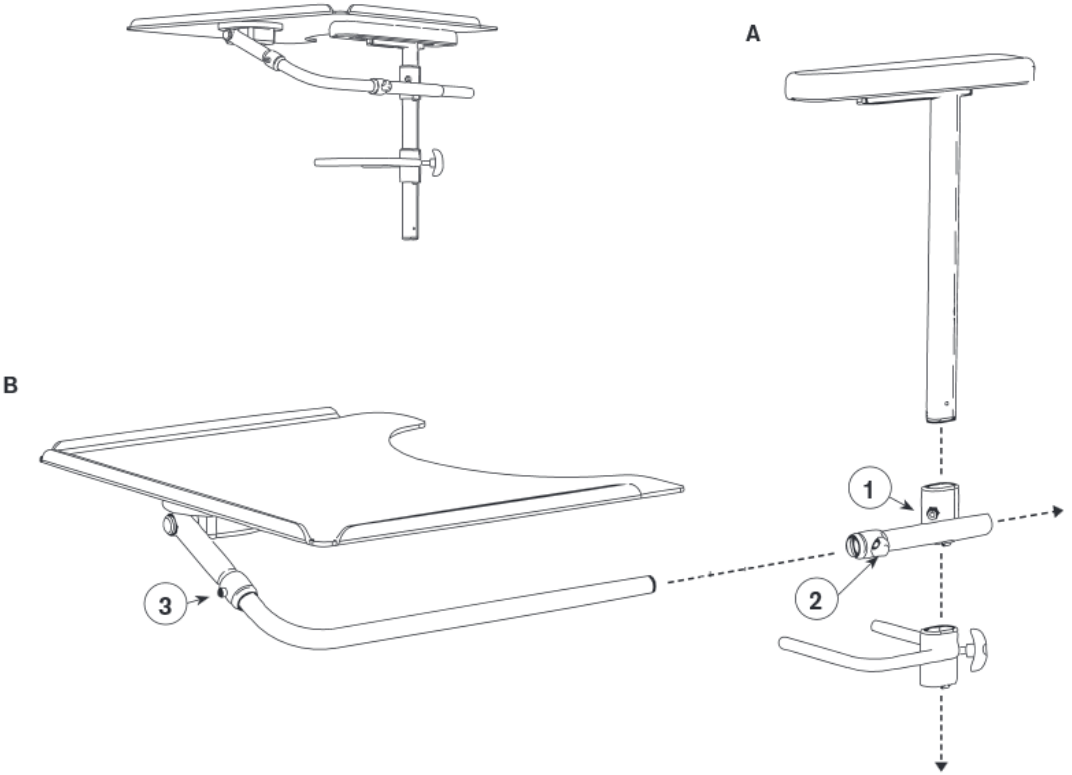

Stellen Sie den Mechanismus (1) auf die gewünschte Höhe ein und schrauben Sie die Schraube fest. Stellen Sie sicher, dass sich alle anderen Regler frei bewegen lassen.

Der Tisch ist auf der richtigen Höhe eingestellt, damit der Nutzer auf der Tischoberfläche arbeiten kann, ohne die Schultern heben zu müssen.

Platzieren Sie den Tisch in der Mitte und ziehen Sie dann Schraube (3) an. Stellen Sie die Tiefe des Tisches ein und ziehen Sie dann Schraube (2) an.

Den Tisch kann weggeklappt oder entfernt werden, in dem die Schraube (2) gelöst wird.

MERCADO MEDIC
Mercado Medic Deutschland GmbH
Augustinusstraße 11e
50226 Frechen Königsdorf
Telefon
T. +49 2234 809 85 87
E-mail und Internet
info@mercadomedic.de
www.mercadomedic.de