

	<p>BEDIENUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG</p>	
	<p>+ REAL® 9000 PLUS KIND</p> <p>HMV-Nr. 26.11.05.0040</p>	<p>Letzte Änderung 04.2020</p> <p>Gültig ab 010607</p>

Standard z.B.:

- Untergestell mit Bremse
- Sitzpolster EMP
- Armlehnen
- Seitenpolster
(auch ohne Lieferbar)
- Velours Bezug

Optional z.B.:

- Fußbrett Zentral
- Bedienhebel unter der
Armlehnen



Standard z.B.:

- Rückenlehne
- Armlehnen
- Seitenkissen 15x8

Optional z.B.:

- Sitzpolster EM
- Schiebegriffe
- Seitenpelotten
- Kopfstütze
- Sonder-Bezug
- H-Rahmen mit
Bremse

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Mercado REAL Stuhl!**

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Ihr Mercado Medic Deutschland Team

LERNEN SIE IHREN REAL 9000 PLUS KIND KENNEN –

BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGS- UND

PFLEGEANLEITUNG DURCH, BEVOR SIE DEN STUHL NUTZEN.

INHALT

ALLGEMEIN:	Seite
ANWENDUNGSBEREICH / INDIKATION	3
CE-ZERTIFIZIERUNG & WIEDEREINSATZ & NUTZUNGSDAUER	3
TECHNISCHE DATEN	4
STANDARD-LIEFERUMFANG & <u>INSPEKTIONSHECKLISTE VOR DER BENUTZUNG DES STUHL</u> S	5
WICHTIGE INFORMATIONEN UND KLASSIFIKATION	6
LAGERUNG UND REINIGUNG	7
WARTUNGSHINWEISE	7
RICHTLINIEN für INDIVIDUELLE ANPASSUNG DES MERCADO MEDIC PRODUKTS	8
EINSTELLUNGEN UND BEDIENUNG:	
BEDIENUNG DER BREMSE	9
BREMSSYSTEM	9
SITZHÖHENEINSTELLUNG	9
ANBRINGEN DER RÜCKENLEHNE	10
EINSTELLEN DER RÜCKENLEHNE	10
EINSTELLEN DER ARMLEHNE & DES SEITENKISSENS	11
EINSTELLEN DES ZENTRALEN FUßBRETT	11
SITZWINKELFUNKTION (STANDARDKONFIGURATION für HMV-Nr. 26.11.05.0040)	12
OPTIONALES ZUBEHÖR:	
EINSTELLEN DES KLEINEN ZENTRALEN FUßBRETT	12
EINSTELLEN DER MEDIC BEIN- UND FUßSTÜTZE	13
EINSTELLEN DER MEDIC WADENSTÜTZE	13
EINSTELLEN DER MEDIC KNIESTÜTZE	13
EINSTELLEN DER KOPFSTÜTZE	14
SITZDREHUNG	14
EINSTELLEN VON ARTHRODESE-SITZELEMENTEN	15
MONTIEREN UND EINSTELLEN VOM ABDUKTIONSKIEGEL	15
MONTIEREN UND EINSTELLEN DER SEITENPELOTTE	16
MONTIEREN UND EINSTELLEN DES HÜFTGURTS	16
MONTIEREN UND EINSTELLEN DES BRUSTGURTS	17
MONTIEREN UND EINSTELLEN DER FLEXIBLEN SITZHOSE & DES TISCHES	17

ANWENDUNGSBEREICH / INDIKATION

Der REAL 9000 PLUS KIND ist ein Kinder-Therapiestuhl zum Positionieren und/oder Trippeln, mit einer SitzhöhenEinstellung per Gasdruckfeder für den Innenbereich auf ebenem Untergrund.

INDIKATIONEN

Verschiedene Muskelkrankheiten, wie z.B. Muskeldystrophie, Muskeldysphasie. Sitzproblematik durch Lähmungen oder erhebliche Kraftminderung der Rumpfhalmuskulatur, so das ein aufrechtes Sitzen ohne umfassende Unterstützung nicht möglich ist oder zu Fehlhaltung, Deformierung und Schmerzen führt. Bewegungseinschränkungen, Deformationen des Körpers, der Rumpfmuskulatur oder der Extremitäten.

Die Indikation für den Stuhl mit elektrischer SitzhöhenEinstellung (EL) sind starke Einschränkungen beim Aufstehen oder die Unfähigkeit eigenständig aufzustehen. Die medizinische Notwendigkeit zur Verordnung von Kinder Therapiestühlen mit Sitzsystemen kann gegeben sein bei:

- Alle muskeldystrophische Erkrankungen
- Alle dysphasischen Muskelerkrankungen
- Alle Neurologische Erkrankungen sowie alle Deformierungen der unteren und oberen Extremitäten bedingt durch Krankheitsbilder die solche Nebenerkrankungen mit sich führen.

KONTRAINDIKATIONEN

Vor einer Versorgung sollten Sie mit Ihrem/Ihrer Arzt /Ärztin abklären, ob Kontraindikationen bestehen.

CE-ZERTIFIZIERUNG

Der REAL 9000 PLUS Kind-Stuhl hat die CE-Zertifizierung gemäß den schwedischen

Vorschriften für medizintechnische Produkte LVFs 2003:11.

WIEDEREINSATZ

Der REAL 9000 PLUS KIND ist, nach Reinigung und Inspektion durch einen von uns autorisierten Fachhändler, im vollen Umfang zum Wiedereinsatz geeignet.

NUTZUNGSDAUER

Die zu erwartende Lebensdauer des Stuhls beträgt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch, Einhaltung der Sicherheits-, Pflege- und Wartungshinweise bis

zu 10 Jahre. Über diesen Zeitraum hinaus kann der Stuhl bei sicherem Zustand weiter verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

REAL 9000 PLUS KIND

Abmessungen des Rahmens* ohne Beinstützen. 43 x 53 cm (BXT)

Gesamthöhe mit niedriger Rückenlehne ca. 60 cm

Einstellungsmöglichkeiten von: Sitzhöhe, Rückenlehnen Neigung / Rückenpolsterposition, Armlehnenhöhe, Bremshebel rechts oder links und eine Breiteinstellung. *Sonstige Einstellungsmöglichkeiten sind abhängig von der Zusammenstellung des Stuhls.*

STANDARKONFIGURATION für HMV-Nr. 26.11.05.0040 :

Sitzhöhe wählbar hoch 40-60 cm oder niedrig 32-46 cm

Sitzbreite 29 cm, optional wählbar: 33,36,40,44 und 48 cm

Sitzbreite Arthrodesse Sitzpolster optional wählbar: 40, 44 und 48 cm**

Sitztiefe 32cm, optional wählbar: 35, 39, 43, 48 und 53 cm**

Sitzwinkel Sitzneigungsverstellung +0° nach vorne / -23° nach hinten (Inklusive Rahmenverlängerung)
Bedienung per Gasfeder unter der Sitzfläche.
Bei dieser Option ist auch eine Sitzneigungsverstellung von +15 bis -8 oder +8 bis -15 einstellbar (siehe Seite 13)

Rückenlehnenpolster-Breite 30 cm, optional wählbar: 25,27,33,35,38,40,42 und 46 cm

Rückenlehnenpolster-Höhe 26 cm, optional wählbar: 20,22,34,36 und 43 cm

Rückenlehnen-Höhe Verstellbereich: 14 cm (Standard), 9 cm (Medic)

Rückenlehnen Winkel Von -10° bis +32°, Bedienung optional wählbar siehe Anpassbogen

Armlehnen Höhe bis 23 cm Einstellbar

Max. Nutzergewicht ergibt sich wahlweise über die Gasdruckfeder Bis 55 Kg oder von 55Kg bis 90 Kg

Gewicht des Standard Produktes 27 Kg inkl. Beinstütze (3 Kg)

Alle Angaben verstehen sich für das Produkt in der STANDARKONFIGURATION für HMV-Nr. 26.11.05.0040!

Polstermaterial Armauflagen	Polyurethan
Polstermaterial Sitzpolster	Polyurethanpolymer
Polstermaterial Rückenlehne	Polyurethanpolymer
Rahmen	Stahlrohr EN 10305-3, Pulverbeschichtet schwarz

* Gemessen von Rohrmitte zur Rohrmitte; Abhängig vom z.B. Sitzpolster und den Armlehnen wird der Stuhl ggf. größer.

** Standard sind nicht alle Sitzbreiten und Sitztiefen kombinierbar, siehe Preisliste. Andere Sitzgrößen auf Anfrage

STANDARD-LIEFERUMFANG REAL 9000 PLUS KIND

- Untergestell mit 4 Rollen XL 100 mm und Bremse
- Sitzpolster 29 x 32 cm (BxT) Ergomedic PLUS
- Sitzwinkelverstellung einstellbar zwischen Werten v. +8 und -15° / +15 und -8° / 0° und -23°, Bedienung per Gasdruckfeder unter der Sitzfläche rechts oder links
- Rückenlehne hoch 33 x 36 cm Ergomedic
- Rückenlehnenverstellung Standard (Lehnenwinkel, Stützwinkel, Höhe: manuell einstellbar)
- Veloursbezug
- Armlehnen 25 cm, schwarzes Kunstleder
- Seitenkissen 15 x 8 / 28 x 8 cm inkl. Befestigung
- Sitzhöhenverstellung per Gasdruckfeder bis 55 Kg, wählbar hoch 40-60 cm oder niedrig 32-46 cm, Bedienung unter der Sitzfläche rechts oder links
- Fußbrett zentral, hochklappbar, L, 30 - 38 cm (B x T: 25 x 18 cm)

Das Sitzpolster, die Rückenlehne und die Armlehnen sind in verschiedenen Maßen und Ausführungen lieferbar. Optional sind auch individuell angefertigte Sitzelemente und weiteres Zubehör erhältlich.
Die aktuellen Preise finden Sie auf unserer Website

INSPEKTIONSHECKLISTE VOR DER ERSTEN BENUTZUNG DES STUHL

- ✓ Stellen Sie die Armlehnen auf die richtige Höhe ein.
- ✓ Befestigen Sie die Rückenlehne und verriegeln Sie den Knopf für die Höheneinstellung der Rückenlehne.
- ✓ Alle Gewindeschrauben müssen auf Festsitzen geprüft werden.
- ✓ Montieren die den Bremshebel (links oder rechts). Nicht bei der elektrische Bremse.
- ✓ Beim Aufstehen oder Hinsetzen muss die Bremse des Stuhls arretiert sein.

Bei elektrische Funktionen:

- ✓ Ziehen Sie den roten Transportschutz von der Ladebuchse
- ✓ Laden Sie den Stuhl lt. Bedienungsanleitung auf

INSPEKTIONSHECKLISTE VOR JEDER BENUTZUNG DES STUHL

- ✓ Allgemeine Sichtkontrolle:
Benutzen Sie niemals ein Gerät, das sich nicht in einwandfreiem Zustand befindet.
- ✓ Überprüfen Sie die Feststellbremse auf Funktion.
- ✓ Beim Aufstehen oder Hinsetzen muss die Bremse des Stuhls arretiert sein.
- ✓ Folgen Sie den Wartungshinweisen, siehe betreffendes Kapitel.
- ✓ Alle Verbindungsteile sind nachzuziehen und zu sichern.

Bei elektrische Funktionen:

- ✓ Laden Sie den Stuhl lt. Bedienungsanleitung auf

WICHTIGE INFORMATIONEN UND KLASSIFIKATION

Der REAL 9000 PLUS KIND-Stuhl verfügt über viele Teile, Zubehör und Funktionen, die nach Bedarf individuell eingestellt werden. Der Stuhl sollte nur von der Person und für den Zweck, für den er ursprünglich bestimmt war, verwendet werden.

Der REAL 9000 PLUS KIND:

- ist nach der EMV-Richtlinie EN 60601-1-1 und EN 60601-1-2 geprüft und zugelassen. Die EMV-Anlage kann unter <http://www.mercado.se/pdf/swe/3/emc.pdf> heruntergeladen werden.
- entspricht der Schutzklasse II, interne Batterie.
- ist in Kategorie B eingestuft.
- muss in der richtigen Verpackung auf einer Palette transportiert werden.
- darf nicht mit Wasser, anderen Flüssigkeiten oder Chemikalien in Berührung kommen.
- Hohe Temperaturen, sowie intensive Sonneneinstrahlung oder ähnliches sollte vermieden werden.
- ist nicht unter 10° Raumtemperatur aufzubewahren.
- ist nur mit Ersatzteilen oder Zubehörteilen von Mercado Medic zugelassen.
- Ist für ein maximales Nutzergewicht von 0-55 Kg oder 55-90 Kg zugelassen, abhängig von der Wahl der Gasdruckfeder. Kontaktieren Sie

Mercado Medic, wenn Sie den Stuhl für schwerere Benutzer anpassen möchten.

- Die Elektronik, falls vorhanden, könnte beeinflusst werden von Mobiltelefonen oder Funkfrequenz-Kommunikationsgeräten.
- darf nicht gefahren werden, wenn sich die Sitzhöhe in der erhöhten Position befindet.

Von einer übermäßigen Nutzung der elektrischen Funktionen ist abzusehen (max. 6 min/h). Bei größerer Auslastung können Defekte entstehen.

Wenn der Stuhl mit einer verstellbaren Sitzneigung ausgestattet ist, muss diese Einstellung beim Aufstehen und Hinsetzen arretiert sein.

Reparaturen und andere technische Arbeiten dürfen nur durch von Mercado Medic autorisierte Personen durchgeführt werden.

Dieses Symbol warnt vor einer Gefahr des Einklemmens.



LAGERUNG UND REINIGUNG

Lagern Sie den Stuhl bei Nichtgebrauch in einer trockenen Umgebung bei Zimmertemperatur. Vermeiden Sie hohe Temperaturen und direktes Sonnenlicht.

Das Untergestell sollte sauber und staubfrei gehalten werden. Zum Desinfizieren Benutzen Sie bitte das Desinfektionsmittel Biguanid Fläche N von der Firma Dr. Schumacher. Führen Sie eine Wischdesinfektion regelmäßig durch. Sprühen sie das Untergestell vor, und anschließend trocken wischen mit einen Sauberen Tuch. nicht mit Wasser, anderen Flüssigkeiten oder Chemikalien reinigen da sonst Beschädigungen entstehen könnten.

Das Velourpolster kann mit Schaumreiniger gereinigt werden:

- Entfernen Sie losen Schmutz aus dem Gewebe.
- Tragen Sie eine dünne Schicht handelsüblichen Schaumreiniger auf und reiben Sie ihn mit einem feuchten Tuch gleichmäßig ein.
- Wischen Sie mit einem sauberen, feuchten Tuch nach; maximal 30° Wassertemperatur.
- Nachdem der Stuhl getrocknet ist, gut absaugen.

Das Sitzpolster, die Rückenlehne und andere gepolsterten Teile sind aus funktionalen Gründen aus atmungsaktivem und wasserdurchlässigem Material. Für den Wiedereinsatz des Hilfsmittel, oder bei starken Verschmutzungen, empfehlen wir das gesamte Polsterelement zu erneuern, da nur in diesem Fall eine 100% Hygiene gewährleistet werden kann.

Unsere, auf Anfrage erhältliche Inkontinenzbezüge sind bis 60° Waschbar, NICHT in der Zentrifuge und NICHT im Trockner beilegen, hier könnten Materialschäden entstehen!

Das Kunstlederpolster kann mit einen Nassen Tuch abgewischt werden bei eine Wassertemperatur bis 30°, und im Anschluss mit Desinfektionsmittel Biguanid Fläche N von der Firma Dr. Schumacher, wie beim Untergestell bearbeitet werden. Beim Wiedereinsatz des Hilfsmittel oder starken Verschmutzungen, empfehlen wir das Polsterelement komplett zu erneuern.

Falls der Stuhl mit elektrischen Einstellungen ausgestattet ist und über einen Monat nicht benutzt wird, sollte die Batterie abgeklemmt werden.

WARTUNGSHINWEISE

Der REAL 9000 PLUS KIND sollte spätestens alle 12 Monate unter Berücksichtigung der früher vorzunehmenden Wartungsintervalle lt. Wartungsvorgaben gewartet werden.

Wartungsintervallen (Falls vorhanden):	Intervall:
Gasdruckfeder Höhenverstellung	Jährlich
Elektrische Höhenverstellung	Jährlich
Gasdruckfeder Sitzneigungsverstellung	Jährlich
Elektrische Sitzneigungsverstellung	Jährlich
Manuelle/Mechanische Bremse	Jährlich
Elektrische Bremse	Jährlich
Schraubverbindungen	Jährlich
Sichtprüfung aller Bauteile auf Beschädigung (z. B. Risse, Brüche)	Jährlich
Sichtprüfung auf Beschädigung beweglicher Teile	Jährlich

ACHTUNG:

- Bei übermäßigem Verschleiß oder bei Nichtaustausch von verschlissenen Produktteilen ist die Sicherheit des Produktes ggf. nicht mehr gewährleistet!
- Störungen oder Defekte dürfen nur vom Hersteller oder autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Führen Sie keine Veränderungen am Produkt durch.
- Bei Reklamationen oder Problemen kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.

Individuelle Anpassungen dürfen nur von Mercado Medic autorisierten Personen durchgeführt werden.

Bei Anpassungen, die als erlaubtes Zubehör gelistet sind, bleibt die CE-Kennzeichnung bestehen.

Wenn eine Anpassung nicht in dieser Liste zu finden ist, muss Mercado Medic um eine schriftliche Genehmigung gebeten werden. Die Anpassung muss vollständig im Ganzen zur Auswertung an Mercado Medic gesendet werden. Mercado Medic wird dann Kontakt aufnehmen mit dem Hersteller/Lieferanten aufnehmen, um eine gegenseitige Vereinbarung zu unterzeichnen. Bei diesem Verfahren führt Mercado Medic eine Risikoanalyse für die Anpassung in Verbindung mit dem Produkt aus. Wenn die Risikoanalyse durchgeführt ist, wird ein schriftlicher Bericht zugesendet.

Die Stühle müssen von Mercado Medic wegen der Produkthaftung überprüft werden, wenn eine Änderung durchgeführt worden ist. Wenn alle folgenden Richtlinien erfüllt sind, wird Mercado Medic voraussichtlich weiterhin eine Produkthaftung übernehmen (CE).

- Polsterteile wie Sitze, Rückenlehnen, Armlehnen, Seitenstützen und Nackenstützen können geändert werden, so lange die Original-Produkt-Messungen oder Schwerpunkte nicht überschritten wird.
- Der Schwerpunktmittelpunkt in Bezug auf den Anwender muss eingehalten werden.
- Polsterteile müssen die aktuellen Brand- und Umweltauforderungen erfüllen.
- Anpassungen unter erheblicher Belastung dürfen nicht über den Rand des Rahmens kommen.

Bei spezieller Anpassung durch Dritte, geht die Haftung für das Produkt auf diesen über. Dies bleibt so, auch wenn das Produkt wieder in seine ursprüngliche Form umgerüstet wird. Wenn diese Umrüstung von einer von Mercado Medic autorisierten Person durchgeführt wird, nimmt Mercado Medic die Haftung zurück lt. CE93/42EEC; Medical Products Direktive MDD.

Bei Fragen zum Thema Anpassungen, nehmen Sie Kontakt auf mit Herrn Andreas Teske (Schwedisch/English) oder über Mercado Medic Deutschland.

Telefon +46 8-555 143 19

E-Mail andreas.teske@mercado.se

BEDIENUNG DER BREMSE

ACHTUNG!!!!



Die Bremse des Stuhls muss beim Aufstehen und sich Hinsetzen immer arretiert sein. Die Bremse muss regelmäßig überprüft werden. Bei Verschleiß des Bremsfußes, muss das Gummi ersetzt werden.

ES GIBT DREI BREMSSYSTEME

Handbremse, Fußbremse und elektrische Bremse.

BEDIENUNG

1. Bremse PLUS-Rahmen 48: Hebel nach vorne drücken
2. Bremse PLUS-Rahmen 43: Hebel nach vorne oder Fußbremse nach unten drücken
3. Elektrische Bremse: Taste drücken

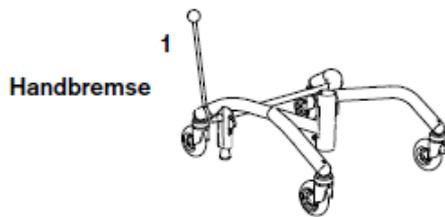

BREMSSYSTEM

Unser Bremssystem funktioniert wie folgt: durch das Betätigen des Bremshebels oder der elektrischen Bremse, bockt das Untergestell sich auf seinen Bremsfüßen auf. Dadurch werden die beiden hinteren Räder entlastet und der Stuhl steht stand- und kippsticher gebremst.

Die Unterschiede bei den Bremshebeln betreffen nur den Bedienkomfort, die Bremswirkung bleibt gleich.



SITZHÖHENFUNKTION

Es gibt zwei Varianten der Sitzhöhenfunktion:

Mit Gasdruckfeder einstellbar oder elektrisch verstellbar. Bei beiden ist eine Standardhöhe (hoch) und eine niedrige Grundeinstellung wählbar. Der Bedienhebel der Gasfeder kann unter dem Sitz oder unter der Armlehne angeordnet werden. Die Bedienung der elektrischen Steuerung ist standardmäßig unter der Armlehne.

Die SitzhöhenEinstellung erfolgt stufenlos, beim REAL 9000 PLUS KIND per Gasfeder.

ACHTUNG! Leichte Personen brauchen bei der Verstellung per Gasfeder ggf. Hilfe beim Heben und Senken der Sitzhöhe.

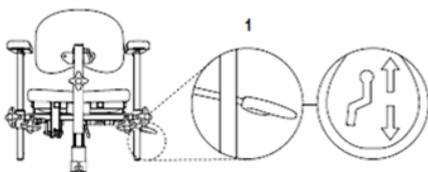


BEDIENUNG

1. SitzhöhenEinstellung per Gasdruckfeder, wird betätigt, indem Sie den Hebel langsam hochziehen. Zum Höher stellen soll der Stuhl entlastet, zum runter stellen belastet werden.

ANBRINGEN DER RÜCKENLEHNE

Um die Rückenlehne anzubringen, drücken Sie den Sicherheitsstift (3) und schieben Sie das Rohr in den Rückenlehnen-Einstellmechanismus (2) hinein.

Um die Rückenlehne zu entfernen, drücken Sie den Sicherheitsstift (3) und schieben Sie das Rohr aus dem Rückenlehnen-Einstellmechanismus (2) heraus.



Arretieren Sie die Rückenlehne durch das Anziehen der Sterngriffschraube (4).


EINSTELLEN DER RÜCKENLEHNE

Es gibt vier Arten von Rückenlehnenfunktionen: Standard, Medic, Komfort und Elektrisch. Alle sind als hohe oder niedrige Ausführung lieferbar (alle abgebildeten Stühle haben die niedrige Ausführung).

BEDIENUNG

1. Höheneinstellung
2. Neigungseinstellung der Rückenlehne

Um die Neigung des Rückenpolsters zu variieren, lösen Sie den Schnellspanner (3), positionieren Sie das Polster im gewünschten Winkel und ziehen Sie den Schnellspanner (3) an.

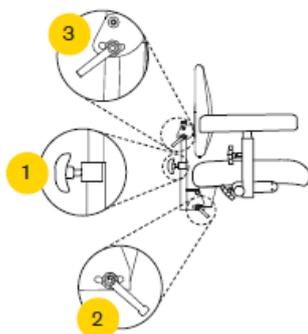


Standard


Um die Höhe der Rückenlehne zu variieren, lösen Sie die Sterngriffschraube (1), positionieren Sie die Rückenlehne auf der gewünschten Höhe und ziehen Sie die Sterngriffschraube (1) an.

Um die Neigung der Rückenlehne zu ändern, lösen Sie die Schraube (2) oder nutzen Sie bei der Komfort-Variante den Bedienehebel der Gasfedereinstellung (2).

Bei der Medic-Variante können Sie durch Lösen der Sterngriffschraube (4) die Sitztiefe einstellen. Ziehen Sie in der gewünschten Position die Sterngriffschraube (4) wieder an.

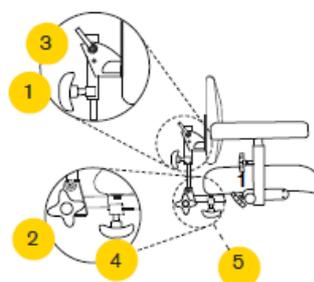

Medic (Optional)

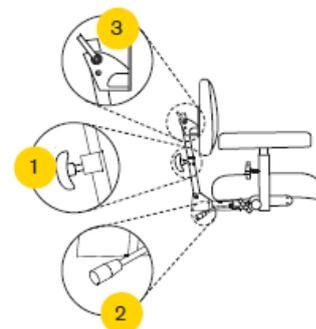

Komfort (Optional)


Alle Rückenlehneeeinstellfunktionen haben separate Sterngriffschrauben für Höhen-, Tiefen- und Neigungseinstellung. Der Medic-Mechanismus ist extra in der Tiefe einstellbar.

3. Neigungseinstellung des Rückenpolsters
4. Tiefeneinstellung

ACHTUNG!

Stellen Sie bei dem Medic-Mechanismus sicher, dass die Rückenlehne maximal bis zur Sicherung herausgezogen ist (5)!

Wenn der Stuhl mit einem elektrischen Rückenlehne-Einstellmechanismus ausgestattet ist, kann der Rückenwinkel über den Schalter unter der Armlehne eingestellt werden.




Elektrisch (optional)


EINSTELLEN DER ARMLEHNE

Sie können die Armlehnen-Position in Höhe und Breite einstellen. Wenn der Stuhl mit klappbaren Armlehnen ausgestattet ist, können diese heruntergeklappt werden. Zum Herausnehmen der

Standardarmlehne, lösen Sie die Schraube (1), drücken Sie den silberfarbenen Sicherheitsstift unten am Armlehnen-Rohr und ziehen Sie die Armlehne komplett heraus.



Armlehne

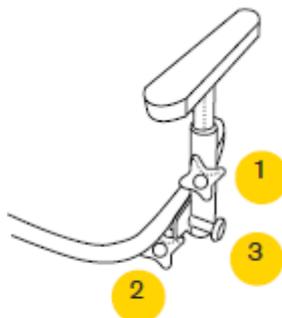

Klappbare Armlehne

BEDIENUNG

1. Höheneinstellung
2. Breiteneinstellung
- Lösen Sie jeweils die Sterngriffschraube, um die Armlehne zu verstellen. Danach festdrehen.
4. Klappmechanismus.
- 5.

EINSTELLEN DES SEITENKISSENS



Sie können das Seitenkissen in Höhe und Abstand zur Hüfte einstellen

Um die Höhe des Seitenkissens anzupassen, lösen Sie die Schraube (1) und positionieren Sie das Seitenkissen in der gewünschten Position. Ziehen Sie die Schraube (1) an, um das Seitenkissen zu fixieren.



Um den Abstand zwischen dem Seitenkissen und der Hüfte anzupassen, lösen Sie die Schraube (2) und positionieren Sie das Seitenkissen in der gewünschten Position. Ziehen Sie die Schraube (2) an, um das Seitenkissen zu fixieren.



EINSTELLEN DES ZENTRALEN FUßBRETTS

Sie können das Fußbrett in Höhe und Neigung einstellen und die Neigung der Beinstütze.

Um die Höhe des Fußbretts anzupassen, lösen Sie die Sterngriffschraube (1) und positionieren Sie das Fußbrett in der gewünschten Position. Ziehen Sie die Sterngriffschraube (1) an, um das Fußbrett zu fixieren.

Um die Neigung des Fußbretts anzupassen, verstellen Sie die Inbusschraube (2). Je mehr Sie die Schraube rausdrehen, desto mehr neigt sich das Fußbrett.



Um die Neigung der Beinstütze anzupassen, lösen und entfernen Sie die Schraube (3) und positionieren Sie das Fußbrett in einer der vorgegebenen Positionen. Platzieren Sie den Abstandsring und die Schraube und ziehen Sie die Schraube (3) an, um die Beinstütze zu fixieren.

SITZWINKELFUNKTION


Es gibt drei Mechanismen zur Sitzneigungseinstellung: per Gasdruckfeder, per Drehspindel oder elektrisch. Die Drehspindel bedienen Sie von der Rückseite des Stuhls. Der Neigungsbereich kann mittels der Muttern eingestellt werden. Der

Bedienhebel für die Gasfeder ist unter dem Sitz (2) oder optional unter der Armlehne (3). Er wird bedient, indem Sie langsam hochziehen. Die elektrische Sitzneigungseinstellung wird standardmäßig mit dem Schalter (4) bedient.


BEDIENUNG

1. Drehspindeleinstellung unter dem Sitz.
2. Bedienhebel der Gasdruckfeder unter dem Sitz.

3. Bedienhebel der Gasdruckfeder unter der Armlehne.
4. Elektrische Steuerung unter der Armlehne.

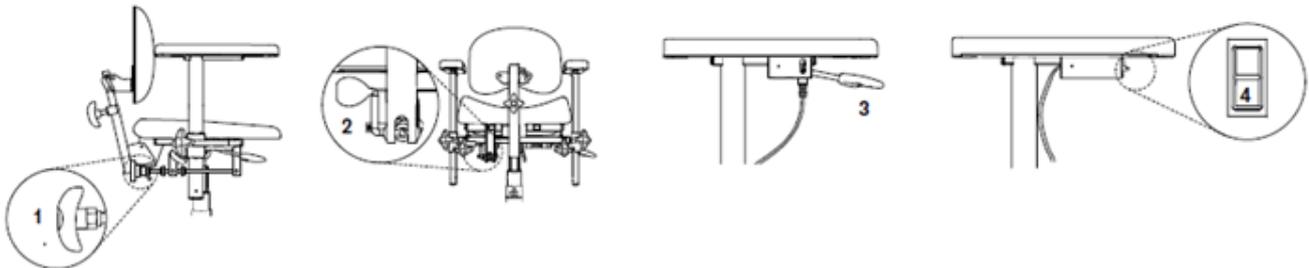

SITZWINKELFUNKTION MIT 3 BEREICHEN (STANDARDFUNKTION für HMV-Nr. 26.11.05.0040)

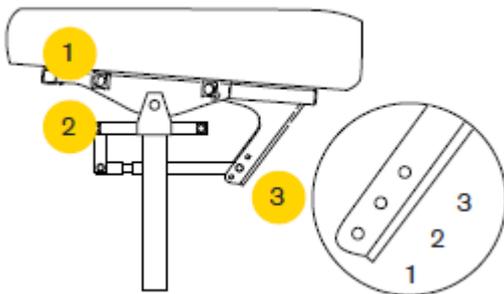

1. Armlehnen, die hier angebracht sind, bewegen sich zusammen mit der Sitzneigung.
2. Armlehnen, die hier angebracht sind, bewegen sich NICHT zusammen mit der Sitzneigung
3. Es gibt drei Positionen für die unterschiedlichen Neigungsbereiche.

- Pos. 1. 15° nach vorne, 8° nach hinten - Standardsitzneigung.
 Pos. 2. 8° nach vorne, 15° nach hinten - aktive Sitzneigung.
 Pos. 3. 0° nach vorne, 23° nach hinten - passive Sitzneigung.

ACHTUNG: Position 3 darf nur eingestellt werden in Kombination mit einer Rahmenverlängerung!

EINSTELLEN DES KLEINEN ZENTRALEN FUßBRETTS (OPTIONAL)

Sie können das Fußbrett in Höhe und Neigung einstellen und die Neigung der Beinstütze.

Um die Höhe des Fußbretts anzupassen, lösen Sie die Sterngriffschraube (1) und positionieren Sie das Fußbrett in der gewünschten Position. Ziehen Sie die Sterngriff-



Schraube (1) an, um das Fußbrett zu fixieren.

Um die Neigung des Fußbretts anzupassen, verstellen Sie die Inbusschraube unter dem Fußbrett (2). Je mehr Sie die Schraube rausdrehen, desto mehr neigt sich das Fußbrett.

Um die Neigung der Beinstütze anzupassen, lösen Sie die kleinere Inbusschrauben (3, an beiden Seiten) und positionieren Sie die Beinstütze in der gewünschten Position. Ziehen Sie die Schrauben (3, an beiden Seiten) an, um die Beinstütze zu fixieren.

EINSTELLEN DER MEDIC BEIN- UND FUßSTÜTZE (OPTIONAL)

Sie können die Fußstütze in Höhe und Neigung einstellen und die Neigung der Beinstütze. Um die Höhe des Fußbretts anzupassen, lösen Sie die Inbusschraube (1) und positionieren Sie das Fußbrett in der gewünschten Position. Ziehen Sie die Schraube (1) an, um das Fußbrett zu fixieren.

Um die Neigung des Fußbretts anzupassen, lösen Sie die Inbus-Schraube (2) und positionieren Sie das Fußbrett in der gewünschten Position. Ziehen Sie die Schraube (2) an, um das Fußbrett zu fixieren.

Um die Neigung der Beinstütze anzupassen, lösen Sie die Inbusschraube (3) und



positionieren Sie die Beinstütze in der gewünschten Position. Ziehen Sie die Schraube (3) an, um die Beinstütze zu fixieren.

EINSTELLEN DER WADENSTÜTZE (OPTIONAL BEI DER MEDIC BEINSTÜTZE)

Sie können die Wadenstütze in Höhe und Winkel einstellen.

Um die Höhe und Winkel der Wadenstütze anzupassen, lösen Sie die Schraube (1) und positionieren Sie die Wadenstütze in der



gewünschten Position. Ziehen Sie die Schraube (1) an, um die Wadenstütze zu fixieren.

EINSTELLEN DER KNIESTÜTZE (OPTIONAL BEI DER MEDIC BEINSTÜTZE)

Sie können die Kniestütze in Höhe und Winkel einstellen.

Um die Höhe der Kniestütze anzupassen, lösen Sie die Schraube (1) und positionieren Sie die Kniestütze in der gewünschten Position. Ziehen Sie die Schraube (1) an, um die Kniestütze zu fixieren.

Um der Winkel der Kniestütze anzupassen, lösen Sie die Schraube (2) und positionieren Sie die

Kniestütze in der gewünschten Position. Ziehen Sie die Schraube (2) an, um die Kniestütze zu fixieren.

3 = Klappmechanismus: ziehen Sie (3) zum entriegeln und schwenken Sie die Kniestütze weg



EINSTELLEN DER KOPFSTÜTZE (OPTIONAL)

Um die **Neigung** der Kopfstütze einzustellen, lösen Sie die Schraube (1) und positionieren Sie das Kopfstützenpolster in der gewünschten Position. Ziehen Sie die Schraube (1) an, um das Polster zu fixieren.

Um die **Tiefe** der Kopfstütze einzustellen, lösen Sie die Schraube (3) und drücken Sie das Kopfstützenpolster nach vorne oder ziehen Sie es nach hinten in die gewünschte Position. Ziehen Sie die Schraube (3) an, um das Poster zu fixieren.

Um die Kopfstütze **seitlich** zu verstellen (nicht möglich bei Kopfstützen NS10, NS20 oder NS30), lösen Sie die Schraube (4) und schieben Sie die Kopfstütze in die gewünschte Position. Ziehen Sie die Schraube (4) an, um das Poster zu fixieren.


Um die Kopfstütze **in der Höhe** zu verstellen, lösen Sie die Sterngriffschrauben (5) und schieben Sie die Kopfstütze hoch oder herunter in die gewünschte Position. Ziehen Sie die Sterngriffschrauben (5) an, um das Poster zu fixieren.



SITZDREHUNG (OPTIONAL)

ACHTUNG!!!!

Stellen Sie sicher, dass der Drehungsmechanismus eingerastet ist, bevor Sie sich hinsetzen oder aufstehen. Die Sitzdrehung wird mit der Hebel (1) bedient.

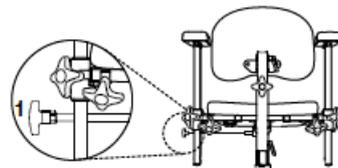


EINSTELLEN VON ARTHRODESE-SITZELEMENTEN (OPTIONAL)

Die Arthrodeese-Elemente können eingestellt werden.

Bei Stühlen ohne Sitzneigungseinstellung finden Sie die Bedienung unter der Vorderkante des Sitzes.

BEDIENUNG


1. Lösen Sie die Sterngriffschraube (1), stellen Sie die gewünschte Neigung ein und ziehen Sie die Schraube wieder an.

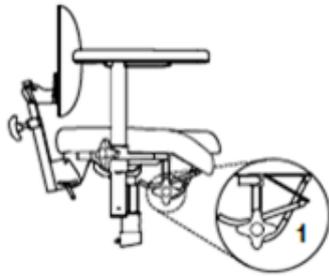

Bei Stühlen mit Sitzneigungseinstellung finden Sie die Bedienung unter der Rückenlehne des Sitzes.

BEDIENUNG

2. Drehen Sie die Drehspindel (2), um das betreffende Element zu verstellen.

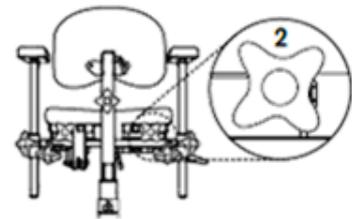

MONTIEREN UND EINSTELLEN VOM ABDUKTIONSKEIL (OPTIONAL)


MONTIEREN

Montieren Sie die Halterung an der Vorderseite des Sitzrahmens und fixieren Sie sie mit den Schrauben (2) sowie die zwei Schrauben an der Vorderseite des Sitzrahmens.


Schieben Sie den Mechanismus (B) in die Halterung und ziehen Sie die Schrauben (3) an um ihn zu fixieren.

EINSTELLEN

Schieben Sie den Abduktionskeil (C) in den Mechanismus. Schieben Sie den Keil auf die richtige Höhe und ziehen Sie die Schraube (4) an um ihn zu fixieren.

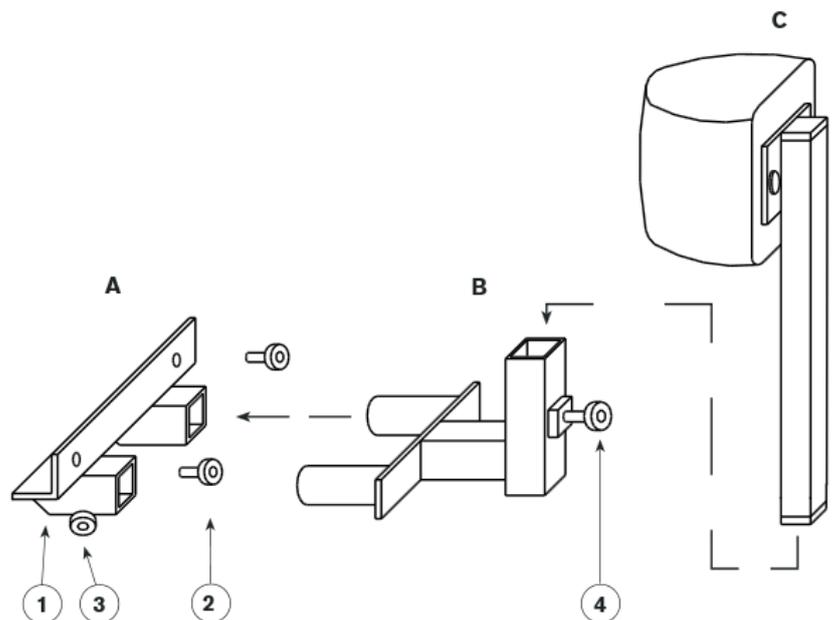

MONTIEREN UND EINSTELLEN DER SEITENPELOTTE (OPTIONAL)

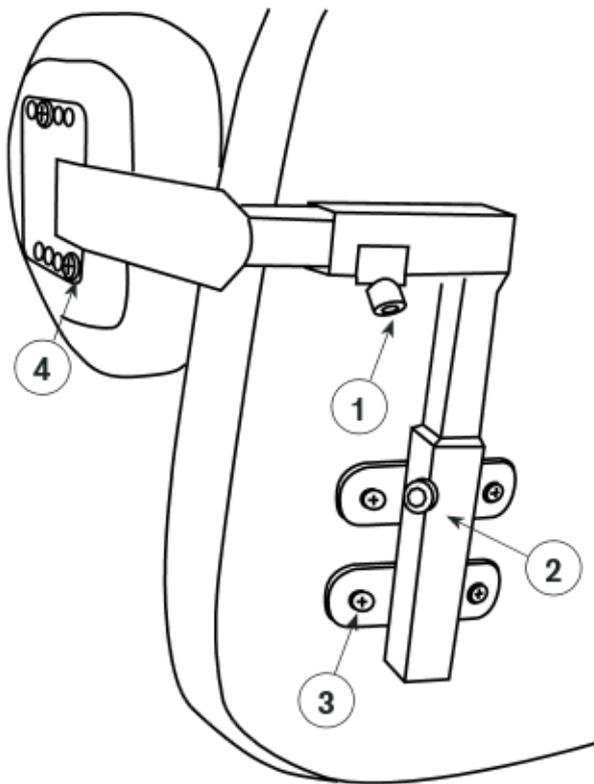

MONTIEREN

Montieren Sie die Seitenpelotte, wie in der Abbildung dargestellt. (Die Abbildung ist von einer Seitenpelotte Standard links.)


Es sind 2 Positionen in der Tiefe möglich. Befestigen Sie das Polster durch die Schrauben (4) in den gewünschten vorgegebenen Löchern im Polster.

EINSTELLEN

Stellen Sie die Höhe und Breite des Seitenpelottenhalterung in eine mittlere Position bevor Sie es am Rückenpolster befestigen. Testen Sie verschiedene Positionen um die richtige zu finden und befestigen Sie den Mechanismus dann mit den Holzschrauben (3).

Die Höhe und Breite der Seitenpelotte können Sie mit Hilfe von Schraube (1) und (2) anpassen.

MONTIEREN UND EINSTELLEN DES HÜFTGURTS (OPTIONAL)

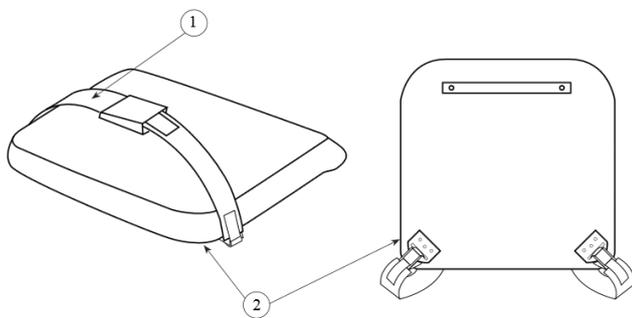

MONTIEREN

Montieren Sie die Klammern (2) auf beiden Seiten in den vorgebohrten Löchern in den hinteren Ecken der Unterseite des Sitzpolsters. Befestigen Sie den Hüftgurt (1) an den Klammern (2).

EINSTELLEN

Passen Sie den Hüftgurt auf die gewünschte Länge an. Nutzen Sie dafür erst das Klett und dann die Clips.

MONTIEREN UND EINSTELLEN DES BRUSTGURTS (OPTIONAL)

MONTIEREN


Montieren Sie die beide oberen und unteren Gurte mit den beigelieferten Klammern. Befestigen Sie den Brustgurt an den Klammern.

EINSTELLEN

Passen Sie den Brustgurt auf die gewünschte Länge an.

ÖFFNEN UND SCHLIEßEN

Nutzen Sie dafür die Clips (1)

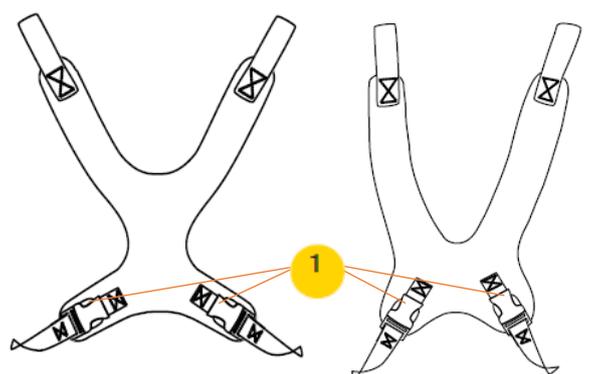

MONTIEREN UND EINSTELLEN DER FLEXIBLEN SITZHOSE (OPTIONAL)


MONTIEREN

Montieren Sie die 2 großen Clips, passend und mittig verteilt unter dem hinteren Bereich des Sitzes.

ACHTUNG: Bitte bohren Sie sich die 2 Großen Clips erst vor damit sie verschraubt werden können.

Nach der Montage unterhalb der hintere Sitzpolsterung , fädeln Sie die dafür vorgesehenen Gurte in den Schlaufen ein und sichern diese mit der Klemmvorrichtung.

Jetzt schrauben Sie bitte die 2 kleinen Clips unterhalb der hinteren Sitzpolsterung, etwas seitlich. Achten Sie bitte darauf das genügend Spielraum übrig bleibt um die dazugehörigen Gurte anatomisch um die Oberschenkel anpassen zu können.

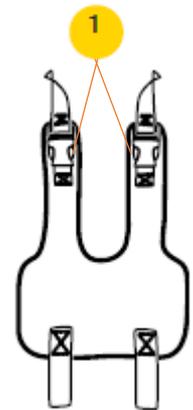

EINSTELLEN

Die Anpassung erfolgt über das Nachziehen der 4 Gurte durch die befestigten Schlaufen an den Clips Vorrichtungen!

ÖFFNEN UND SCHLIEßEN

Nutzen Sie dafür die Clips (1)


MONTIEREN UND EINSTELLEN DES TISCHES (OPTIONAL)

Montieren Sie den Tisch gemäß Bild A und B auf der linken herausgenommenen Armlehne. Montieren Sie die Armlehne wieder auf dem Stuhl und stellen Sie die richtige Höhe ein.

Stellen Sie den Mechanismus (1) auf die gewünschte Höhe ein und schrauben Sie die Schraube fest. Stellen Sie sicher, dass sich alle anderen Regler frei bewegen lassen.

Der Tisch ist auf der richtigen Höhe eingestellt, damit der Nutzer auf der Tischoberfläche arbeiten kann, ohne die Schultern heben zu müssen.

Platzieren Sie den Tisch in der Mitte und ziehen Sie dann Schraube (3) an. Stellen Sie die Tiefe des Tisches ein und ziehen Sie dann Schraube (2) an.

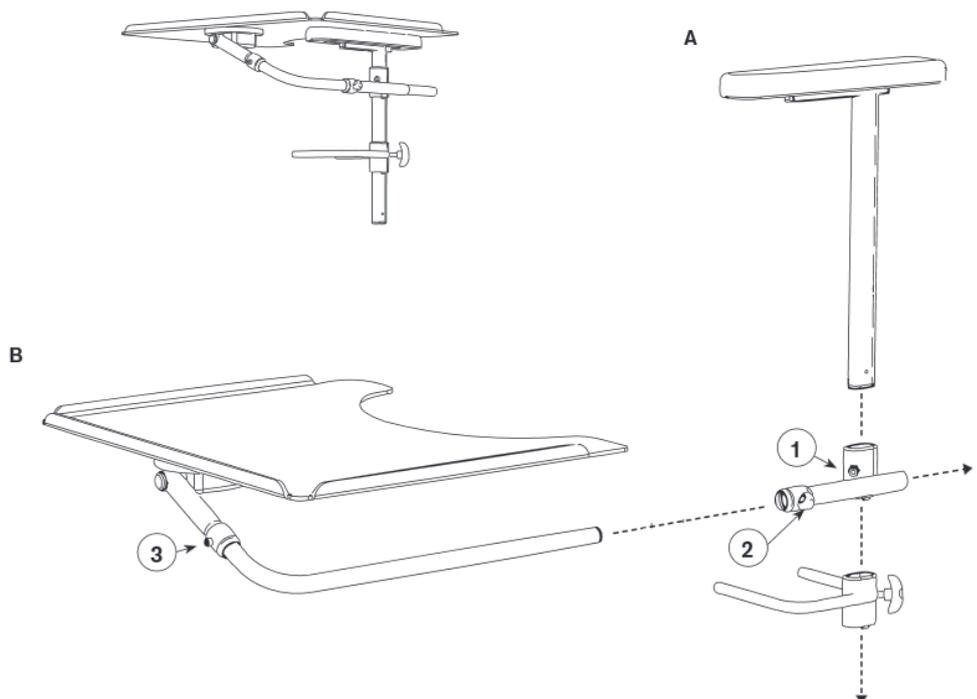

Den Tisch kann weggeklappt oder entfernt werden, in dem die Schraube (2) gelöst wird.